Alton
INNOVATION CREATES BRILLIANT FUTURE

Alton (Shanghai)
Medical Instruments Co.,Ltd



# ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ГИБКОЙ ЭНДОСКОПИИ

# СОДЕРЖАНИЕ

## Одноразовые инструменты



| | |
|---|---|
| Измерительная линейка | стр. 01-02 |
| Инструменты для ESD | стр. 03-09 |
| Клип-аппликаторы | стр. 10-11 |
| Инструменты для EMR | стр. 12-16 |
| Инструменты для ERCP | стр. 17-19 |
| Щипцы для биопсии | стр. 20-23 |
| Щипцы для удаления инородных тел | стр. 24-27 |
| Захватывающие и извлекающие корзины | стр. 28-29 |
| Принадлежности | стр. 30-35 |


## Многоразовые инструменты


| | |
|---|---|
| Щипцы для биопсии | стр. 36-38 |
| Щипцы для удаления инородных тел | стр. 39-42 |
| Захватывающие и извлекающие корзины | стр. 43-44 |
| Электрохирургические электроды | стр. 45-47 |
| Принадлежности | стр. 48-51 |

# Одноразовая измерительная линейка



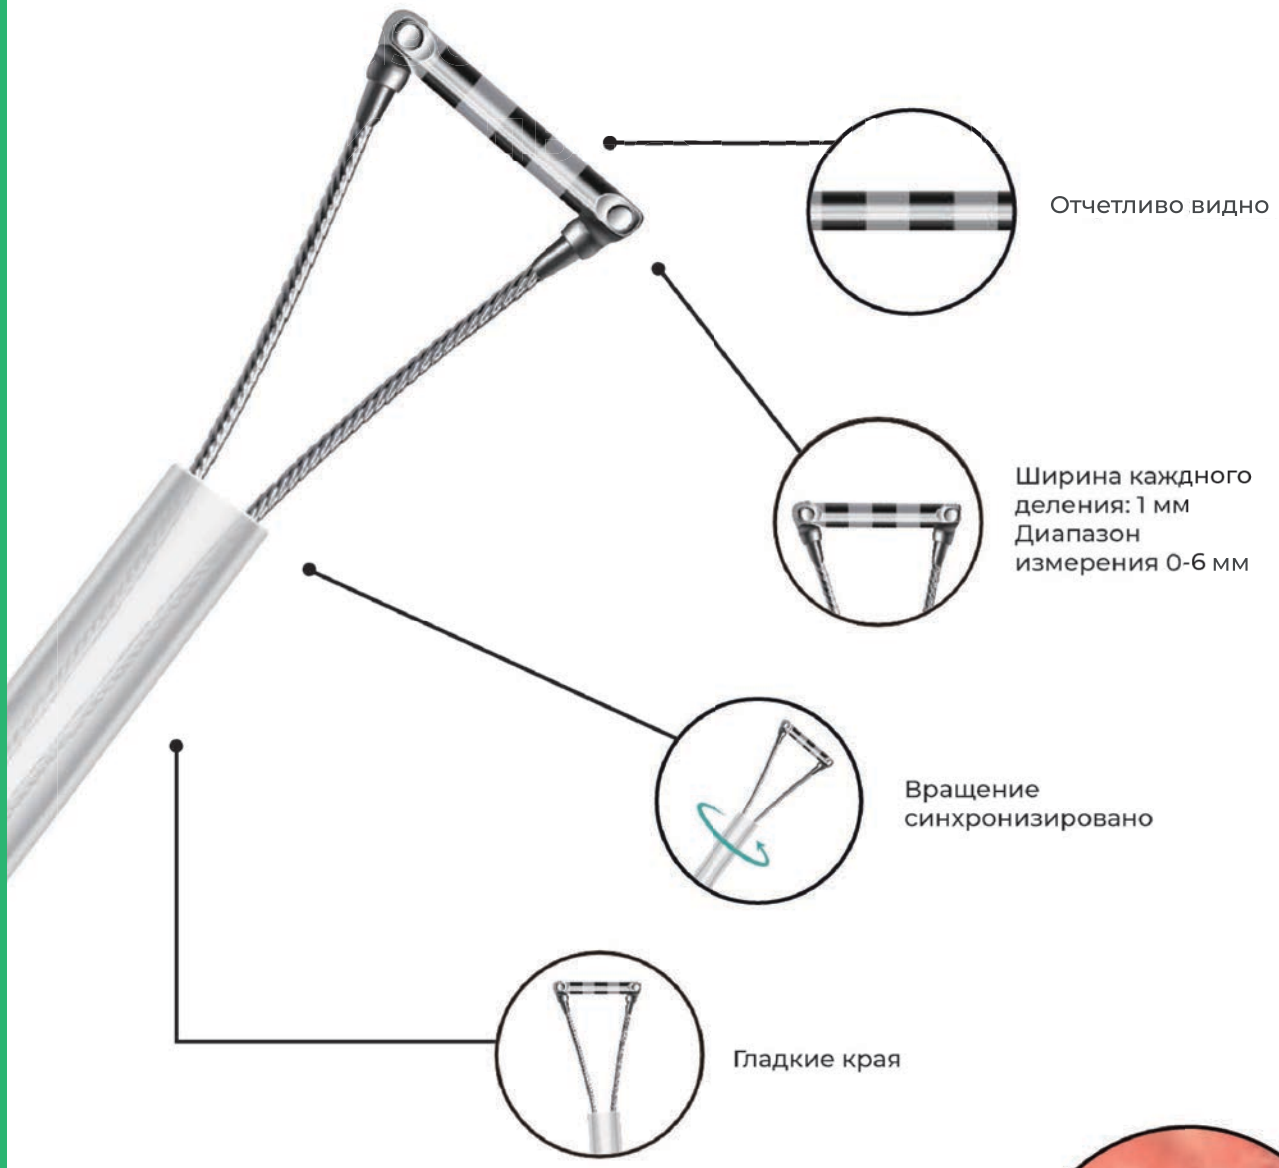


При портальной гипертензии измерения варикозного расширения вен пищевода




| Артикул | Диаметр | Длина | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-D2415MR | Ø2.4 мм | 1500 мм | Гастроскопия |
| AF-D2416MR | Ø2.4 мм | 1600 мм | Гастроскопия |
| AF-D2417MR | Ø2.4 мм | 1700 мм | Гастроскопия |
| AF-D2418MR | Ø2.4 мм | 1800 мм | Гастроскопия |
| AF-D2421MR | Ø2.4 мм | 2100 мм | Колоноскопия |
| AF-D2423MR | Ø2.4 мм | 2300 мм | Колоноскопия |

# Одноразовые инструменты для ESD





## Одноразовый электрохирургический нож шарикового типа (нож CT)

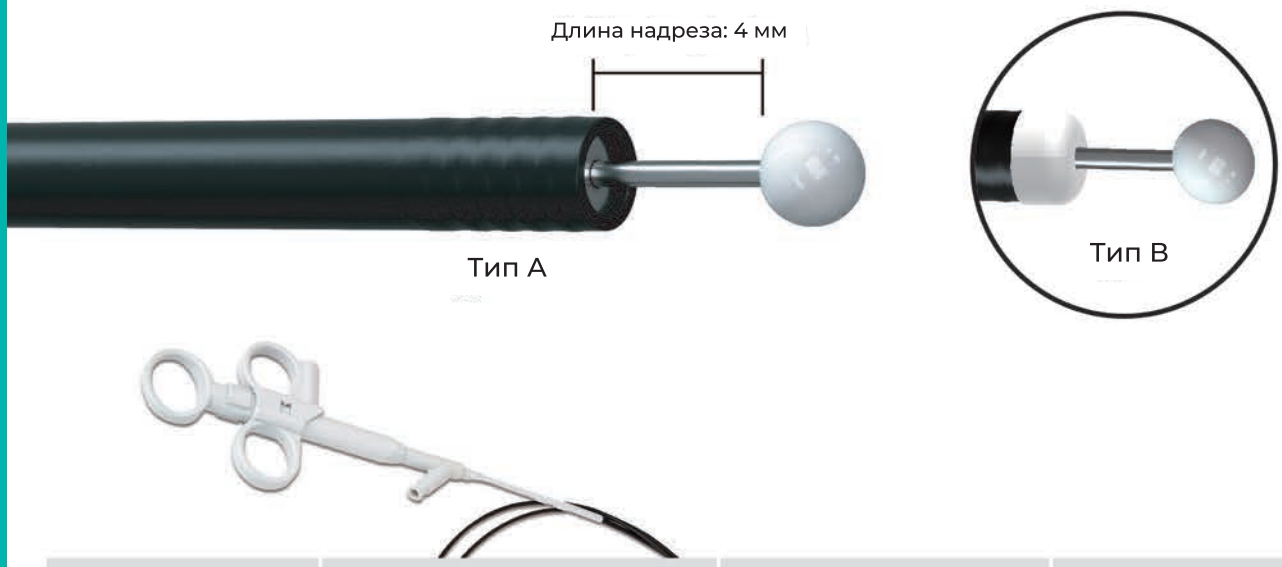


| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-D1812EB-3 (A/B) | Ø1.8x1200 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-D1815EB-3 (A/B) | Ø1.8x1500 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-D2418EB-3 (A/B) | Ø2.4x1800 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2423EB-3 (A/B) | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |

Изолированный наконечник позволяет производить безопасный разрез, диссекцию и промывание.

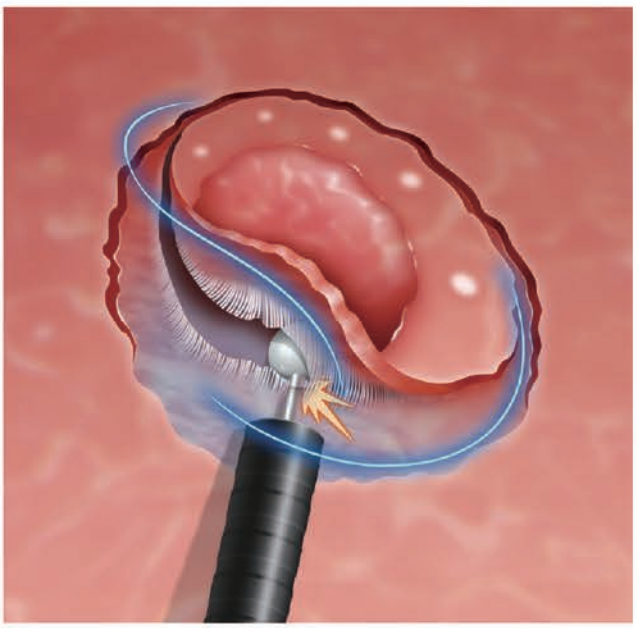

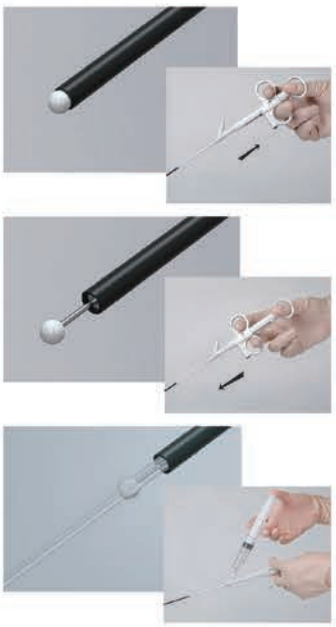


1 Ввод наконечника

2 Резка
Рассечение (наконечник наружу)

3 Распыление
(наконечник наружу)

## Одноразовый электрохирургический нож (шарикового типа)

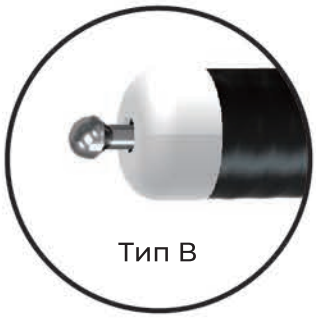








| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-D1812EB(A/B) | Ø1.8x1200мм | ≥Ø2.0мм | Бронхоскопия |
| AF-D1815EB(A/B) | Ø1.8x1500мм | ≥Ø2.0мм | Гастроскопия |
| AF-D2418EB(A/B) | Ø2.4x1800мм | ≥Ø2.8мм | Гастроскопия |
| AF-D2423EB(A/B) | Ø2.4x2300мм | ≥Ø2.8мм | Колоноскопия |

Шариковый наконечник может выполнить отметку, надрез и остановить кровотечение с функцией промывания.

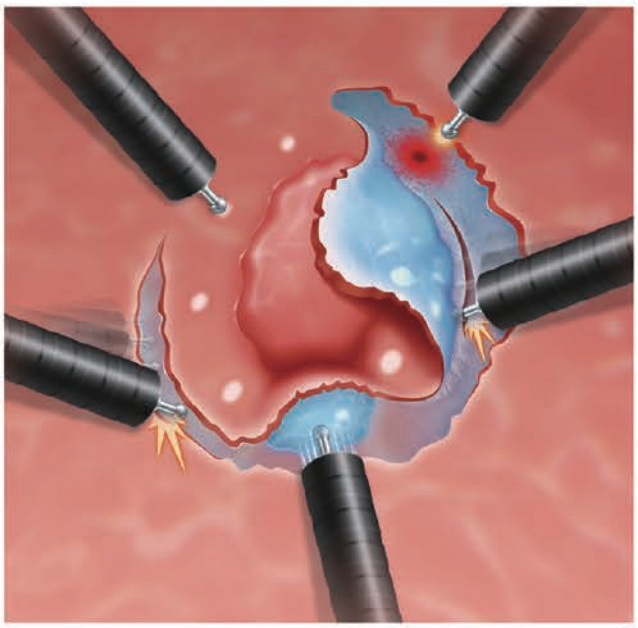



1 Маркировка коагуляция (ввод наконечника)



2 Резка Рассечение (наконечник наружу)



3 Распыление (наконечник наружу)


# Одноразовый электрохирургический нож цилиндрической формы (квадратный)






| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-D2416EN-2 | Ø2.4x1600 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2418EN-2 | Ø2.4x1800 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2423EN-2 | Ø2.4x2300 мм | ≥ Ø2.8 мм | Колоноскопия |

Выдвижной квадратный нож может выполнять аккуратный надрез во всех направлениях, может выполнить отметку и промывание.

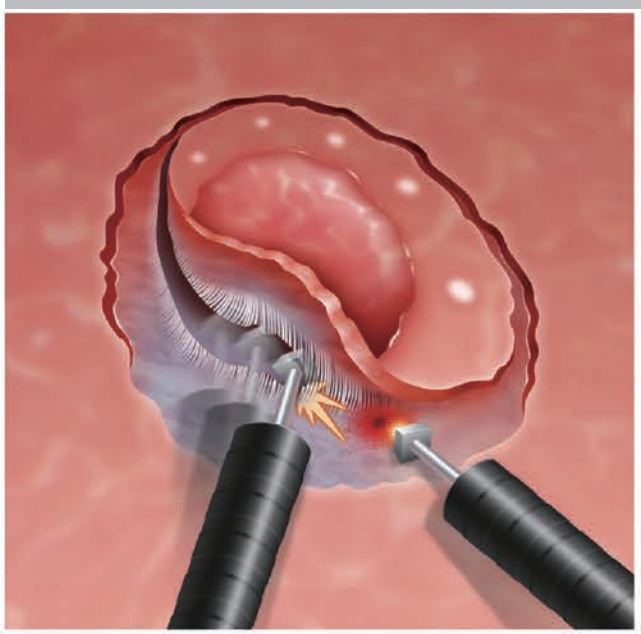



1 Маркировка коагуляция (ввод наконечника)



2 Резка Рассечение (наконечник наружу)



3 Распыление (наконечник наружу)


# Одноразовый электрохирургический нож цилиндрической формы (туннельный)







| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-D2416EN | Ø2.4x1600мм | ≥Ø2.8мм | Гастроскопия |
| AF-D2418EN | Ø2.4x1800мм | ≥Ø2.8мм | Гастроскопия |
| AF-D2423EN | Ø2.4x2300мм | ≥Ø2.8мм | Колоноскопия |

Выдвижной наконечник иглы может выполнять отметку и надрез с функцией промывания.

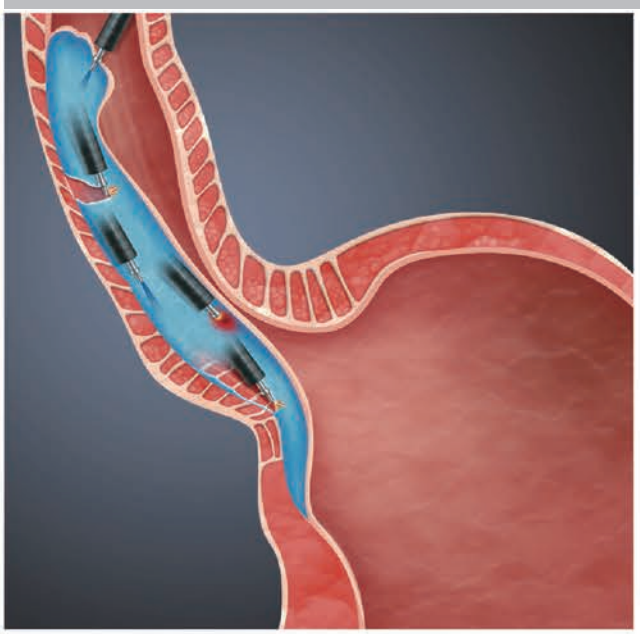

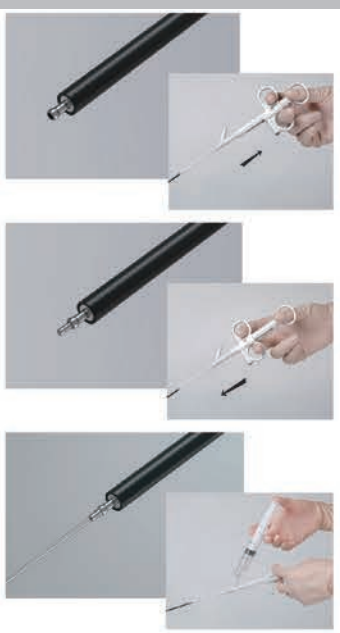

1. Маркировка коагуляция (ввод наконечника)
2. Резка Рассечение (наконечник наружу)
3. Распыление (наконечник наружу)

## Одноразовые электрохирургические щипцы (вращающиеся, гемостатические)




| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-D2418EHR-A | Ø2.4x1800 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2423EHR-A | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |

Выполняется отметка, надрез и остановка кровотечения, когда щипцы открываются и закрываются. Медленный поворот упрощает проведение операции.

## Одноразовые электрохирургические щипцы (вращающиеся, крючковые)




| Номер изделия | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-D2418EHR-B | Ø2.4x1800 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2423EHR-B | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |

Для быстрого надреза спайки. Медленный поворот способствует быстрому доступу.


## Одноразовые электрохирургические щипцы (вращающиеся, диссекционные)




| Номер изделия | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-D2418EHR-C | Ø2.4x1800 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2423EHR-C | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |

Для быстрого надреза спайки. Медленный поворот способствует быстрому доступу.


## Одноразовые электрохирургические щипцы (вращающиеся, крючковые)

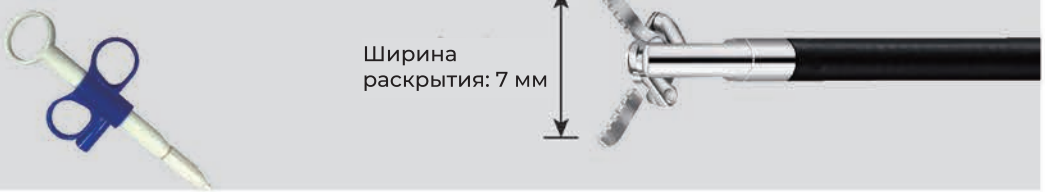


| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-D2418ESR | Ø2.4x1800 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2423ESR | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |

Для быстрого надреза спайки. Медленный поворот способствует быстрому доступу.

## Одноразовые электрохирургические щипцы (вращающиеся, диссекционные)

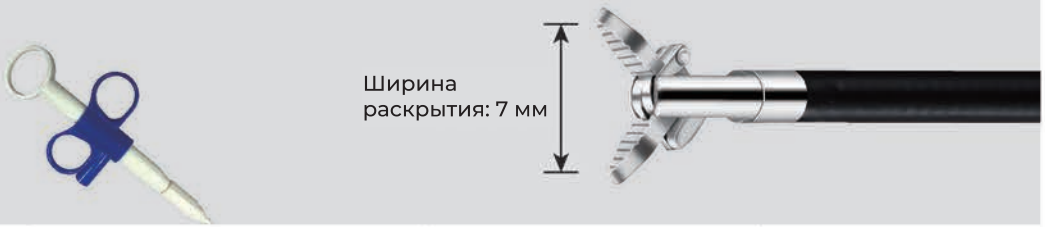


| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-D2418EFR | Ø2.4x1800 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2423EFR | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |

Для быстрого надреза спайки. Медленный поворот способствует быстрому доступу.

## Одноразовые электрохирургические щипцы (вращающиеся)




| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-D2418ETR | Ø2.4x1800 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2423ETR | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |

Для быстрого надреза спайки. Медленный поворот способствует быстрому доступу.

# Одноразовые клип-аппликаторы






Вращение 360°



Легко снимается
Более безопасный




Большая ширина конструкции
удовлетворяет потребности
в клиническом лечении



Ширина
раскрытия
9 мм / 11 мм
14 мм / 17 мм



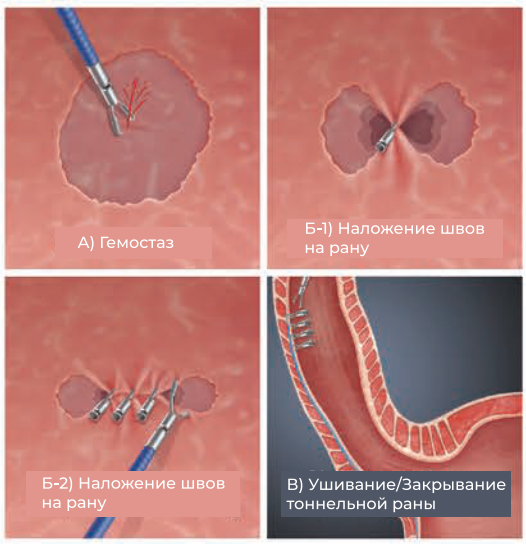




После того как зажим выйдет
из эндоскопа, переместите его
на целевую область и постепенно
открывайте зажим, потянув за ручку




После установки в нужное положение
постепенно закрывайте зажим,
нажимая на ручку до тех пор, пока
не почувствуете сопротивление




Ослабьте фиксатор, сильнее
надавив на рукоятку

| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Ширина раскрытия | Область раскрытия |
|---|---|---|---|---|
| AF-D2418JZR-9 | Ø2.4 мм x 1800 мм | ≥Ø2.8 мм | 9 мм | Гастроскопия |
| AF-D2423JZR-9 | Ø2.4 мм x 2300 мм | ≥Ø2.8 мм | 9 мм | Колоноскопия |
| AF-D2418JZR-11 | Ø2.4 мм x 1800 мм | ≥Ø2.8 мм | 11 мм | Гастроскопия |
| AF-D2423JZR-11 | Ø2.4 мм x 2300 мм | ≥Ø2.8 мм | 11 мм | Колоноскопия |
| AF-D2418JZR-14 | Ø2.4 мм x 1800 мм | ≥Ø2.8 мм | 14 мм | Гастроскопия |
| AF-D2423JZR-14 | Ø2.4 мм x 2300 мм | ≥Ø2.8 мм | 14 мм | Колоноскопия |
| AF-D2418JZR-17 | Ø2.4 мм x 1800 мм | ≥Ø2.8 мм | 17 мм | Гастроскопия |
| AF-D2423JZR-17 | Ø2.4 мм x 2300 мм | ≥Ø2.8 мм | 17 мм | Колоноскопия |

# Одноразовые инструменты для EMR

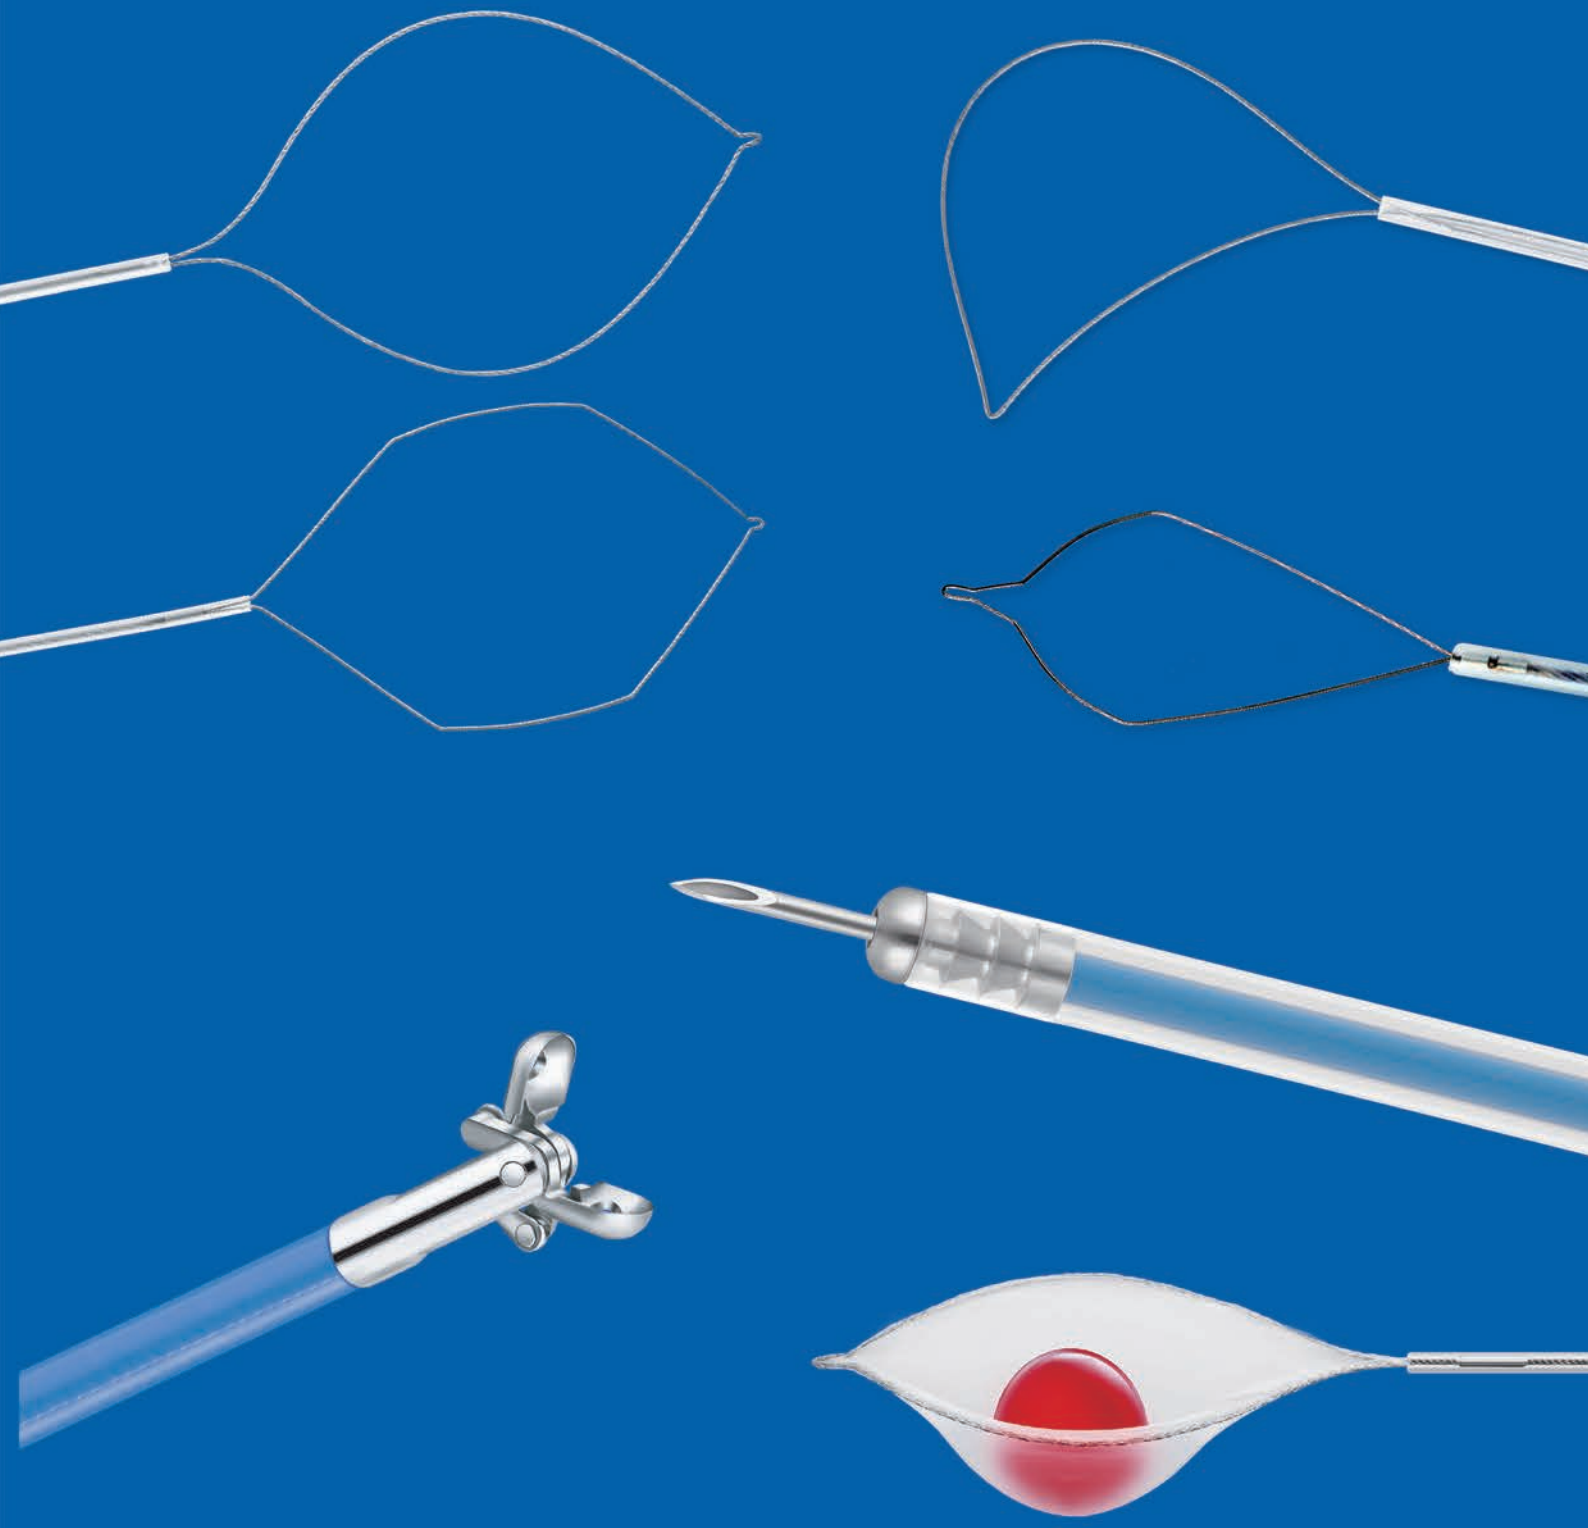

## Одноразовая электрохирургическая петля (овальная форма)

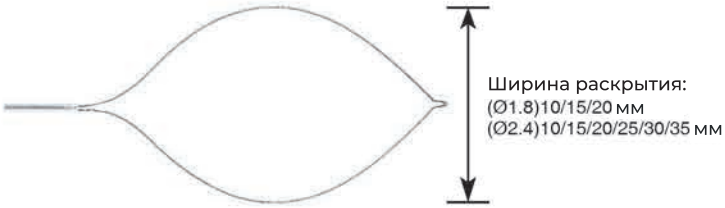


Ширина раскрытия:
(Ø1.8)10/15/20 мм
(Ø2.4)10/15/20/25/30/35 мм

Для отсечения полипов током высокой частоты.
Нити из специального сплава легко контролируют резку.

| Артикул (не вращающаяся) | Артикул (вращающаяся) | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|---|
| AF-D1810DT | AF-D1810DTR | Ø1.8x1000 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-D1812DT | AF-D1812DTR | Ø1.8x1200 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-D1815DT | AF-D1815DTR | Ø1.8x1500 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-D1816DT | AF-D1816DTR | Ø1.8x1600 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-D1825DT | AF-D1825DTR | Ø1.8x2500 мм | ≥Ø2.0 мм | Энтероскопия |
| AF-D2416DT | AF-D2416DTR | Ø2.4x1600 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2418DT | AF-D2418DTR | Ø2.4x1800 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2421DT | AF-D2421DTR | Ø2.4x2100 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-D2423DT | AF-D2423DTR | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| Встроенная эргономическая ручка для удобного и немедленного использования. Петля может поворачиваться. | | | | |

## Одноразовая электрохирургическая петля (шестиугольная форма)

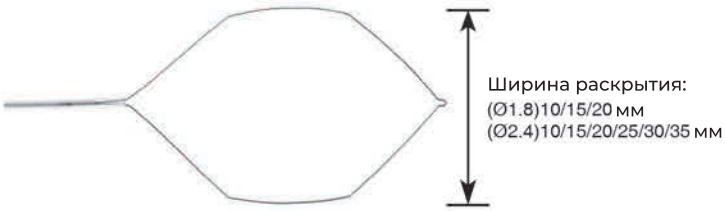


Ширина раскрытия:
(Ø1.8)10/15/20 мм
(Ø2.4)10/15/20/25/30/35 мм

Для отсечения полипов током высокой частоты.
Нити из специального сплава легко контролируют резку.

| Артикул (не вращающаяся) | Артикул (вращающаяся) | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|---|
| AF-D1810DL | AF-D1810DLR | Ø1.8x1000 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-D1812DL | AF-D1812DLR | Ø1.8x1200 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-D1815DL | AF-D1815DLR | Ø1.8x1500 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-D1816DL | AF-D1816DLR | Ø1.8x1600 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-D1825DL | AF-D1825DLR | Ø1.8x2500 мм | ≥Ø2.0 мм | Энтероскопия |
| AF-D2416DL | AF-D2416DLR | Ø2.4x1600 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2418DL | AF-D2418DLR | Ø2.4x1800 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2421DL | AF-D2421DLR | Ø2.4x2100 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-D2423DL | AF-D2423DLR | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| Встроенная эргономическая ручка для удобного и немедленного использования. Петля может поворачиваться. | | | | |

## Одноразовая электрохирургическая петля (форма полумесяца)

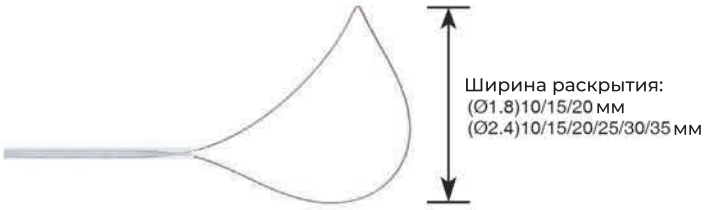


Для отсечения полипов током высокой частоты.
Нити из специального сплава легко контролируют резку.

| Артикул (не вращающаяся) | Артикул (вращающаяся) | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|---|
| AF-D1810DB | AF-D1810DBR | Ø1.8x1000 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-D1812DB | AF-D1812DBR | Ø1.8x1200 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-D1815DB | AF-D1815DBR | Ø1.8x1500 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-D1816DB | AF-D1816DBR | Ø1.8x1600 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-D1825DB | AF-D1825DBR | Ø1.8x2500 мм | ≥Ø2.0 мм | Энтероскопия |
| AF-D2416DB | AF-D2416DBR | Ø2.4x1600 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2418DB | AF-D2418DBR | Ø2.4x1800 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2421DB | AF-D2421DBR | Ø2.4x2100 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-D2423DB | AF-D2423DBR | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| Петля может поворачиваться. | | | | |

## Одноразовая холодная петля (двойная проволока из нержавеющей стали)




Режут полип высокочастотным током, можно резать холодным способом.
Нити из специального сплава легко контролируют резку.

| Артикул (не вращающаяся) | Артикул (вращающаяся) | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|---|
| AF-D1810DC-1(A) | AF-D1810DC-1(B) | Ø1.8x1000 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-D1812DC-1(A) | AF-D1812DC-1(B) | Ø1.8x1200 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-D1815DC-1(A) | AF-D1815DC-1(B) | Ø1.8x1500 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-D1816DC-1(A) | AF-D1816DC-1(B) | Ø1.8x1600 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-D1825DC-1(A) | AF-D1825DC-1(B) | Ø1.8x2500 мм | ≥Ø2.0 мм | Энтероскопия |
| AF-D2416DC-1(A) | AF-D2416DC-1(B) | Ø2.4x1600 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2418DC-1(A) | AF-D2418DC-1(B) | Ø2.4x1800 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2421DC-1(A) | AF-D2421DC-1(B) | Ø2.4x2100 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-D2423DC-1(A) | AF-D2423DC-1(B) | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| Петля может поворачиваться. | | | | |

## Одноразовая холодная петля (одинарная проволока из нержавеющей стали)




Режут полип высокочастотным током, можно резать холодным способом.
Нити из  пециального сплава легко контролируют резку.

| Артикул (не вращающаяся) | Артикул (вращающаяся) | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|---|
| AF-D1810DM | AF-D1810DMR | Ø1.8x1000 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-D1812DM | AF-D1812DMR | Ø1.8x1200 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-D1815DM | AF-D1815DMR | Ø1.8x1500 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-D1816DM | AF-D1816DMR | Ø1.8x1600 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-D1825DM | AF-D1825DMR | Ø1.8x2500 мм | ≥Ø2.0 мм | Энтероскопия |
| AF-D2416DM | AF-D2416DMR | Ø2.4x1600 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2418DM | AF-D2418DMR | Ø2.4x1800 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2421DM | AF-D2421DMR | Ø2.4x2100 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-D2423DM | AF-D2423DMR | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| Петля может поворачиваться. | | | | |

## Одноразовая инъекционная игла



Функция защиты
с ограничителем

Наконечник иглы
из нержавеющей стали,
алмазное сечение.
Более острый при введении
в ткань



Использование внутренней и внешней оболочек из тефлона обеспечивает высокую скорость потока, а впрыск - быструю и плавную подачу

AF-D **** PN ** **

- Длина иглы
- Диаметр иглы
- Диаметр трубки и рабочая длина

| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Длина иглы | Диаметр | Область применения |
|---|---|---|---|---|---|
| AF-D1810PN**** | Ø 1.8x1000 мм | ≥ Ø 2.0 мм | 4/5 мм | 23/25G | Бронхоскопия |
| AF-D1816PN**** | Ø 1.8x1600 мм | ≥ Ø 2.0 мм | 4/5/6 мм | 21/23/25G | Гастроскопия |
| AF-D1825PN**** | Ø 1.8x2500 мм | ≥ Ø 2.0 мм | 4/5/6 мм | 23/25G | Бронхоскопия |
| AF-D2416PN**** | Ø 2.4x1600 мм | ≥ Ø 2.8 мм | 4/5/6 мм | 21/23/25G | Гастроскопия |
| AF-D2418PN**** | Ø 2.4x1800 мм | ≥ Ø 2.8 мм | 4/5/6 мм | 21/23G | Гастроскопия |
| AF-D2421PN**** | Ø 2.4x2100 мм | ≥ Ø 2.8 мм | 4/5/6 мм | 21/23/25G | Колоноскопия |
| AF-D2423PN**** | Ø 2.4x2100 мм | ≥ Ø 2.8 мм | 4/5/6 мм | 21/23/25G | Колоноскопия |

## Одноразовые щипцы для биопсии (тип «Овальные бранши, фенестрированные бранши»)



| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-D1810DG | Ø1.8x1000 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-D1812DG | Ø1.8x1200 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-D1816DG | Ø1.8x1600 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-D2416DG | Ø2.4x1600 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2418DG | Ø2.4x1800 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2421DG | Ø2.4x2100 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-D2423DG | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |

Для удаления небольших полипов и коагуляции мелких сосудов.


## Одноразовая захватывающая петля с корзинкой




| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-D1810GW(A) | Ø1.8x1000 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-D1816GW(A) | Ø1.8x1600 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-D2418GW(A) | Ø2.4x1800 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2423GW(A) | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |

Простой способ удаления тромбов, полипов и инородных тел.


## Одноразовая захватывающая петля с сетчатой корзинкой

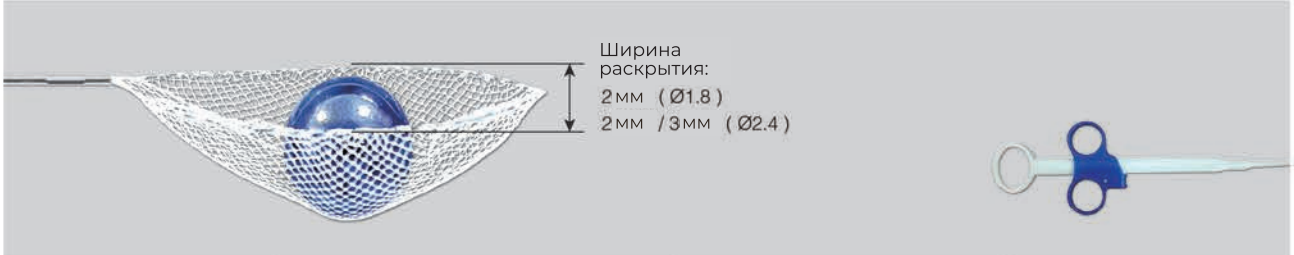



| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-D1810GW(B) | Ø1.8x1000 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-D1816GW(B) | Ø1.8x1600 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-D2418GW(B) | Ø2.4x1800 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2423GW(B) | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |

Простой способ удаления тромбов, полипов и инородных тел.

# Одноразовые инструменты для ERCP

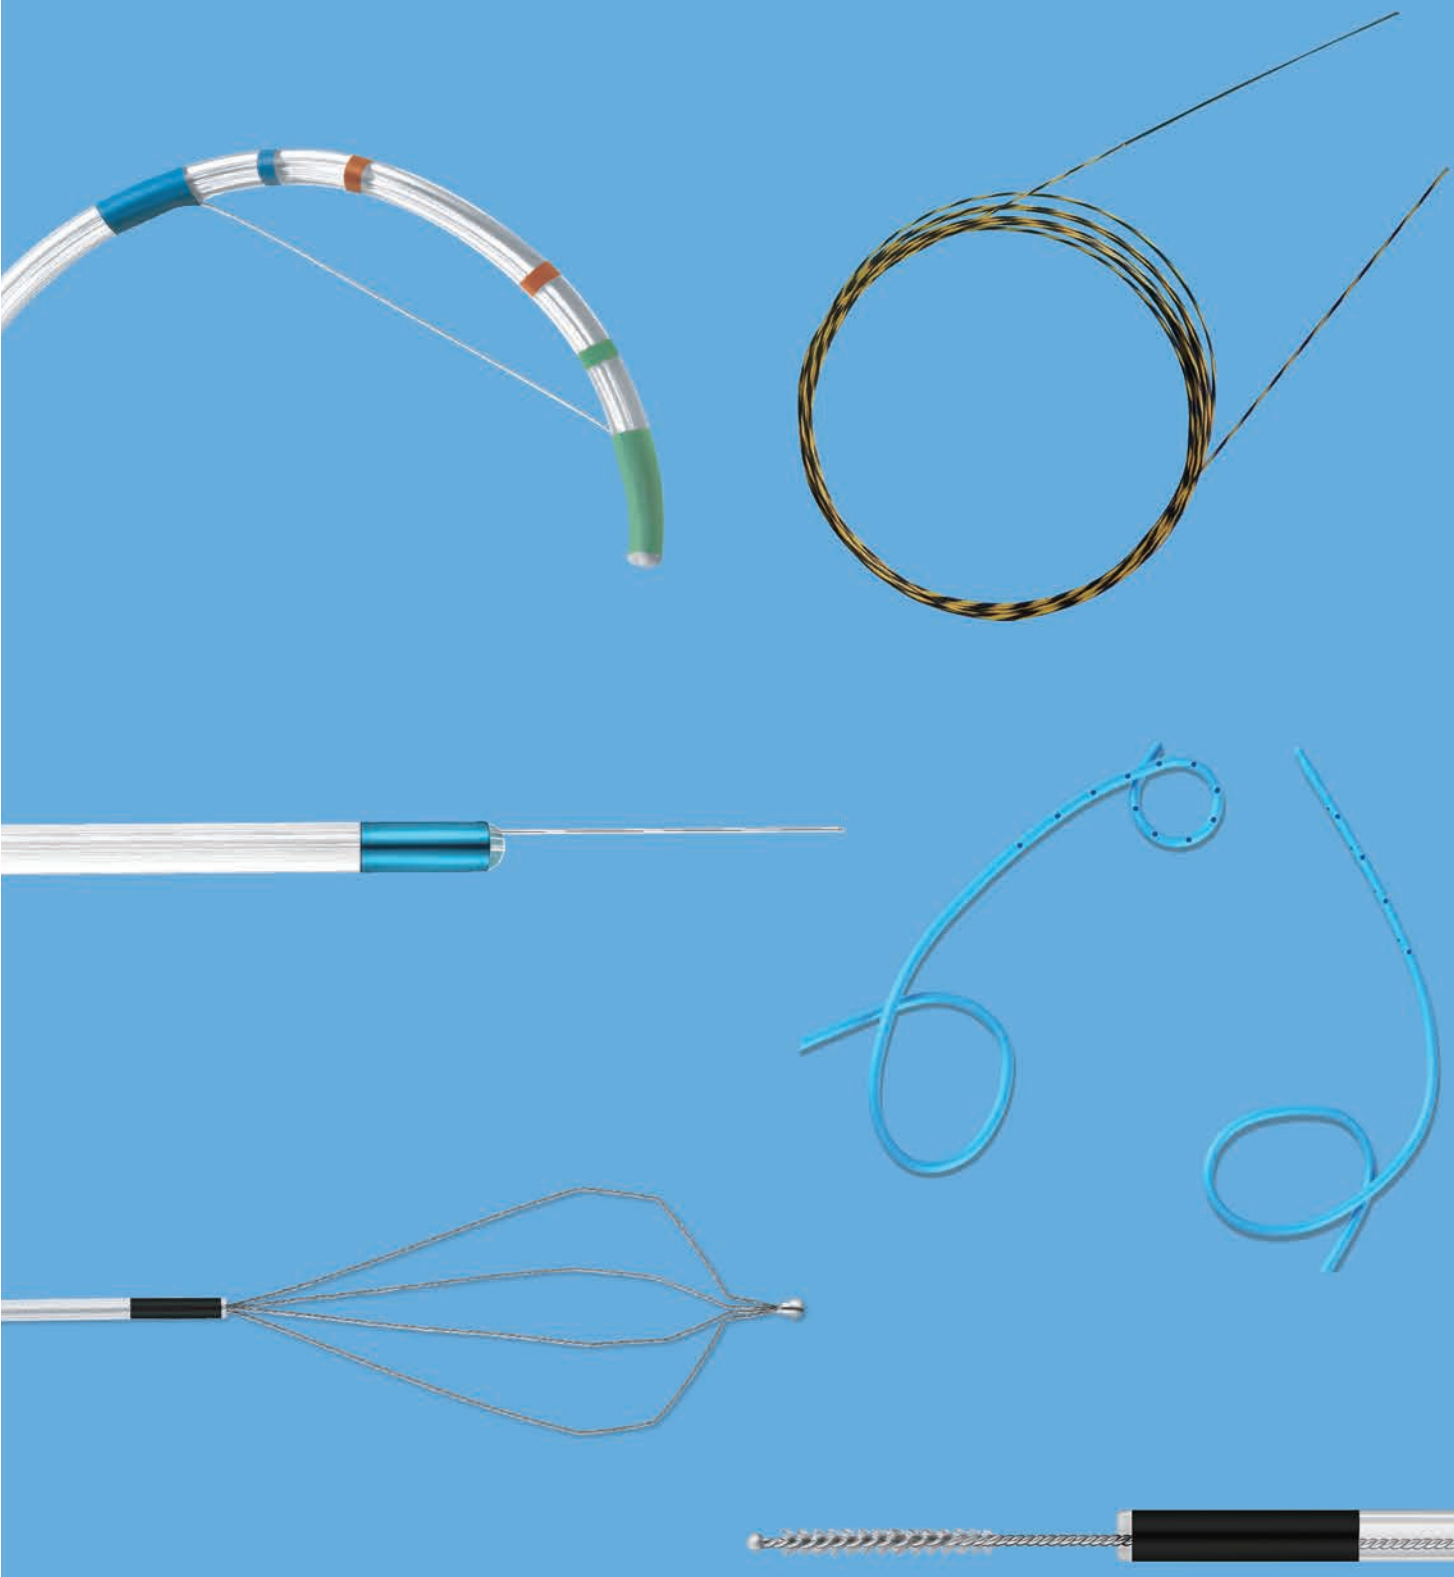


## Проволочный проводник

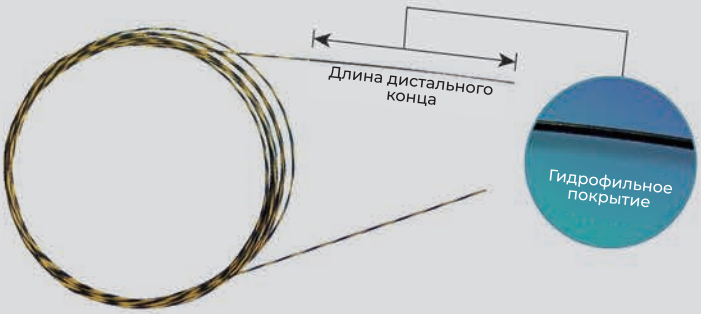


1. Кончик очень скользкий с низким коэффициентом трения. Плавная интубация
2. Желто черная поверхность, которую легко заметить
3. Широкий диапазон доступных диаметров

| Артикул | Длина | Длина дистального конца | Диаметр (Дюйм) |
|---|---|---|---|
| AF-D2526QW05 | 2600 мм | 50 мм | .025" |
| AF-D2545QW05 | 4500 мм | 50 мм | .025" |
| AF-D3526QW05 | 2600 мм | 50 мм | .035" |
| AF-D3545QW05 | 4500 мм | 50 мм | .035" |
| AF-D3826QW05 | 2600 мм | 50 мм | .038" |
| AF-D3845QW05 | 4500 мм | 50 мм | .038" |

## Назобилиарный дренажный катетер

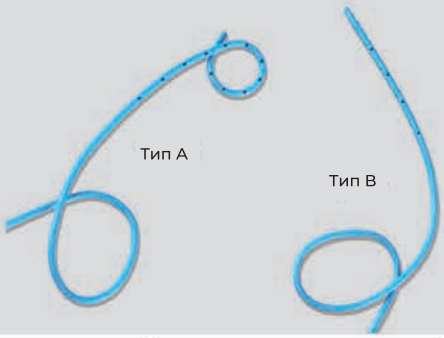



1. Форма хвоста предотвращает выпадение
2. Хороший дренажный эффект
3. Хорошая гибкость, легко проходит на узких участках

| Артикул | Форма | Длина | Диаметр |
|---|---|---|---|
| AF-D7017BDA | Тип А | 1700 мм | 7Fr |
| AF-D7024BDA | Тип А | 2400 мм | 7Fr |
| AF-D7025BDA | Тип А | 2500 мм | 7Fr |
| AF-D8517BDA | Тип А | 1700 мм | 8.5Fr |
| AF-D8524BDA | Тип А | 2400 мм | 8.5Fr |
| AF-D8525BDA | Тип А | 2500 мм | 8.5Fr |
| AF-D7017BDB | Тип В | 1700 мм | 7Fr |
| AF-D7024BDB | Тип В | 2400 мм | 7Fr |
| AF-D7025BDB | Тип В | 2500 мм | 7Fr |
| AF-D8517BDB | Тип В | 1700 мм | 8.5Fr |
| AF-D8524BDB | Тип В | 2400 мм | 8.5Fr |
| AF-D8525BDB | Тип В | 2500 мм | 8.5Fr |

## Одноразовый сфинктеротом

| Артикул | A | B | Тип |
|---|---|---|---|
| AF-D0720DJ2 | 7мм | 20мм |  Двухпросветный |
| AF-D0725DJ2 | 7мм | 25мм | |
| AF-D0730DJ2 | 7мм | 30мм | |
| AF-D0720DJ3 | 7мм | 20мм |  Трехпросветный |
| AF-D0725DJ3 | 7мм | 25мм | |
| AF-D0730DJ3 | 7мм | 30мм | |

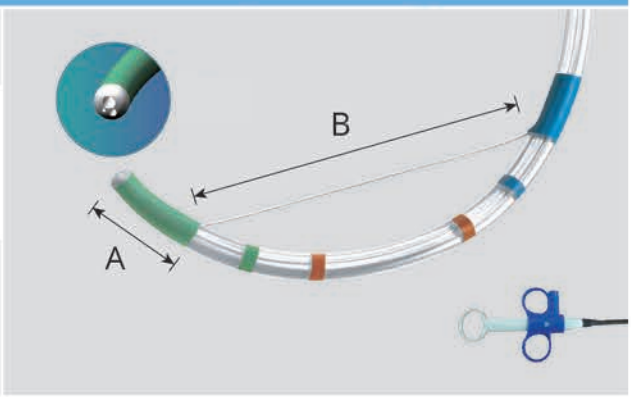



## Одноразовый сфинктеротом игольчатого типа

| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Тип |
|---|---|---|---|
| AF-D2421DZ2 | Ø2.4x2100 мм | ≥Ø2.8 мм |  Двухпросветный |
| AF-D2421DZ3 | Ø2.4x2100 мм | ≥Ø2.8 мм |  Трехпросветный |



## Одноразовые корзинки для ERCP

| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Тип |
|---|---|---|---|
| AF-D2421GL-1 | Ø2.4x2100 мм | ≥Ø2.8 мм |  Двухпросветный |
| AF-D2421GL-2 | Ø2.4x2100 мм | ≥Ø2.8 мм |  Трехпросветный |

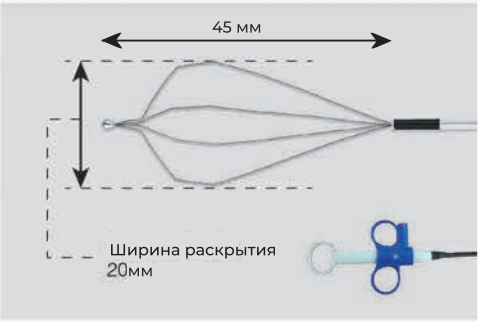



## Одноразовые цитологические ерши для ERCP

| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Тип |
|---|---|---|---|
| AF-D2421WB2 | Ø2.4x2100 мм | ≥Ø2.8 мм |  Двухпросветный |




# Одноразовые щипцы для биопсии

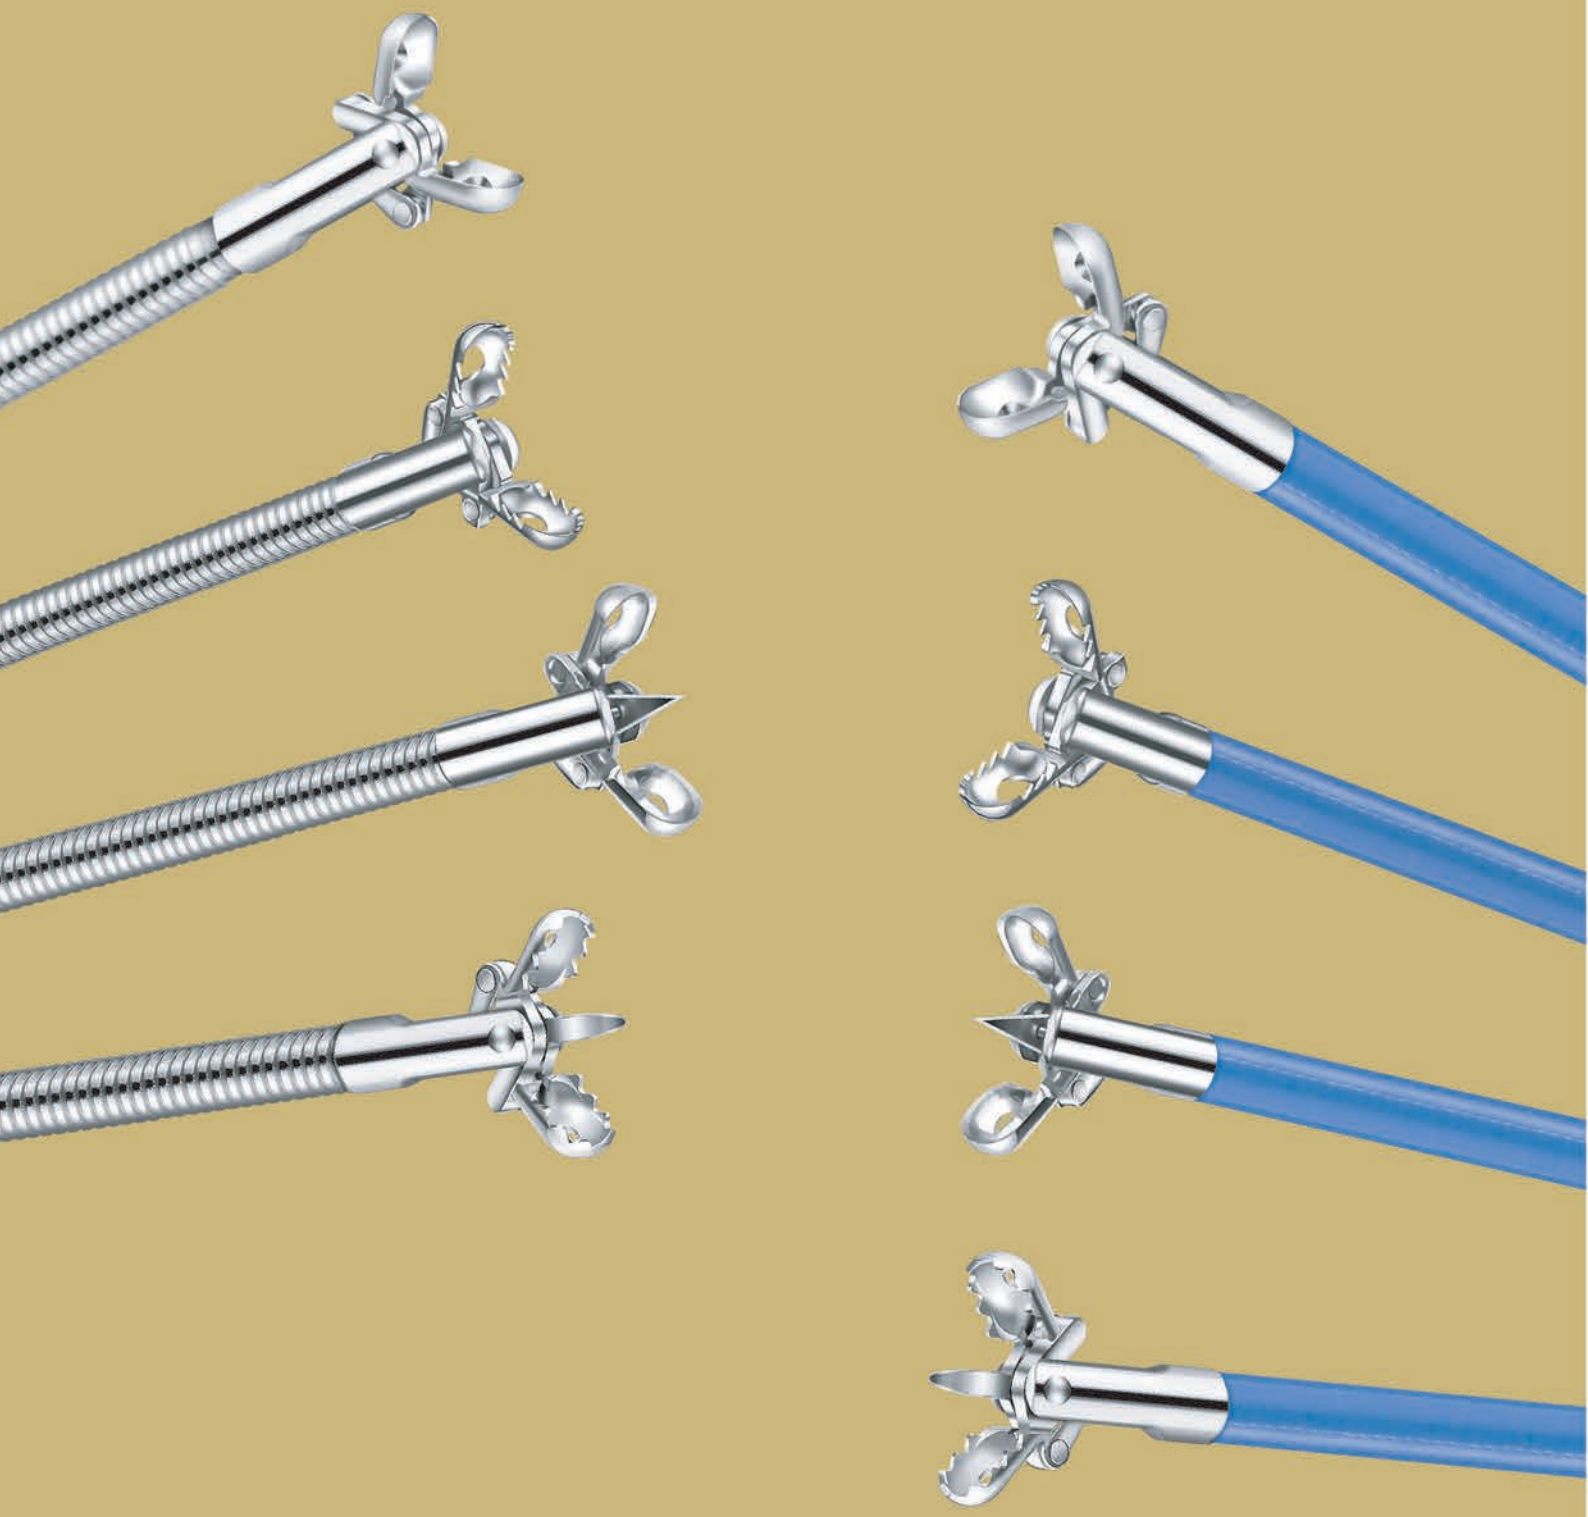


## Одноразовые щипцы для биопсии (овальные бранши)

| Артикул (не вращающ.) | Артикул (вращающ.) | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|---|
| AF-D1010BT | AF-D1010BTR | Ø1.0мм x 1000 мм | ≥Ø1.2 мм | Урология |
| AF-D1810BT | AF-D1810BTR | Ø1.8мм x 1000 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-D1812BT | AF-D1812BTR | Ø1.8мм x 1200 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-D1816BT | AF-D1816BTR | Ø1.8мм x 1600 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-D2416BT | AF-D2416BTR | Ø2.4 мм x 1600 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2418BT | AF-D2418BTR | Ø2.4 мм x 1800 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2421BT | AF-D2421BTR | Ø2.4 мм x 2100 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-D2423BT | AF-D2423BTR | Ø2.4 мм x 2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-D3023BT | AF-D3023BTR | Ø3.0мм x 2300 мм | ≥Ø3.2 мм | Колоноскопия |

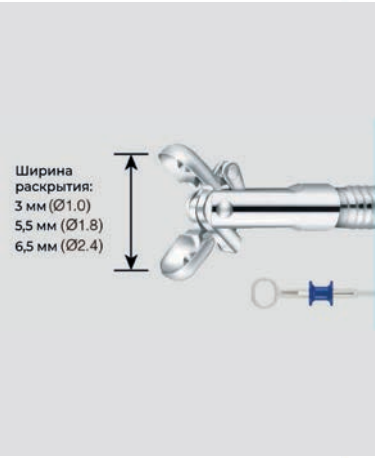



## Одноразовые щипцы для биопсии (овальные бранши с тифлоном)

| Артикул (не вращающ.) | Артикул (вращающ.) | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|---|
| AF-D1010BTC | AF-D1010BTCR | Ø1.0мм x 1000 мм | ≥Ø1.2 мм | Урология |
| AF-D1810BTC | AF-D1810BTCR | Ø1.8мм x 1000 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-D1812BTC | AF-D1812BTCR | Ø1.8мм x 1200 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-D1816BTC | AF-D1816BTCR | Ø1.8мм x 1600 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-D2416BTC | AF-D2416BTCR | Ø2.4 мм x 1600 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2418BTC | AF-D2418BTCR | Ø2.4 мм x 1800 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2421BTC | AF-D2421BTCR | Ø2.4 мм x 2100 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-D2423BTC | AF-D2423BTCR | Ø2.4 мм x 2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-D3023BTC | AF-D3023BTCR | Ø3.0мм x 2300 мм | ≥Ø3.2 мм | Колоноскопия |

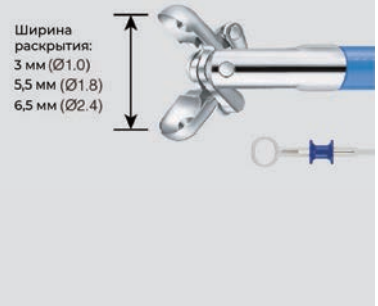



## Одноразовые щипцы для биопсии (бранши типа «Аллигатор»)

| Артикул (не вращающ.) | Артикул (вращающ.) | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|---|
| AF-D1810BU | AF-D1810BUR | Ø1.8мм x 1000 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-D1812BU | AF-D1812BUR | Ø1.8мм x 1200 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-D1816BU | AF-D1816BUR | Ø1.8мм x 1600 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-D2416BU | AF-D2416BUR | Ø2.4мм x 1600 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2418BU | AF-D2418BUR | Ø2.4 мм x 1800 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2421BU | AF-D2421BUR | Ø2.4 мм x 2100 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-D2423BU | AF-D2423BUR | Ø2.4 мм x 2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-D2823BU | AF-D2823BUR | Ø2.8 мм x 2300 мм | ≥Ø3.0 мм | Колоноскопия |

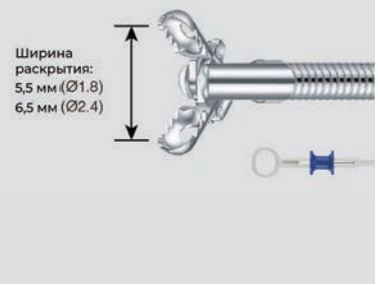


## Одноразовые щипцы для биопсии (бранши типа «Аллигатор»)

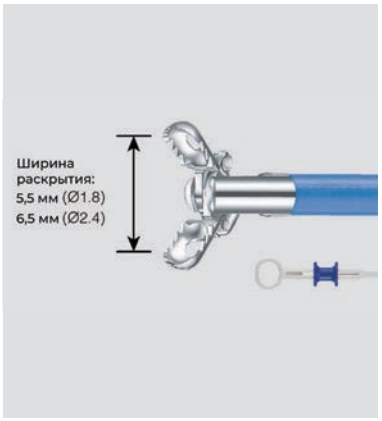



| Артикул (не вращающ.) | Артикул (вращающ.) | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|---|
| AF-D1810BUC | AF-D1810BUCR | Ø1.8мм x 1000 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-D1812BUC | AF-D1812BUCR | Ø1.8мм x 1200 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-D1816BUC | AF-D1816BUCR | Ø1.8мм x 1600 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-D2416BUC | AF-D2416BUCR | Ø2.4мм x 1600 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2418BUC | AF-D2418BUCR | Ø2.4 мм x 1800 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2421BUC | AF-D2421BUCR | Ø2.4 мм x 2100 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-D2423BUC | AF-D2423BUCR | Ø2.4 мм x 2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-D2823BUC | AF-D2823BUCR | Ø2.8 мм x 2300 мм | ≥Ø3.0 мм | Колоноскопия |

## Одноразовые щипцы для биопсии (овальные бранши, с иглой)

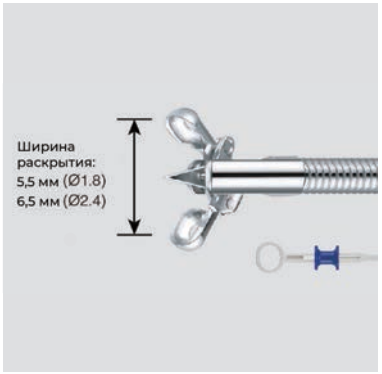


| Артикул (не вращающ.) | Артикул (вращающ.) | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|---|
| AF-D1810BW | AF-D1810BWR | Ø1.8мм x 1000 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-D1812BW | AF-D1812BWR | Ø1.8мм x 1200 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-D1816BW | AF-D1816BWR | Ø1.8мм x 1600 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-D2416BW | AF-D2416BWR | Ø2.4мм x 1600 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2418BW | AF-D2418BWR | Ø2.4 мм x 1800 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2421BW | AF-D2421BWR | Ø2.4 мм x 2100 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-D2423BW | AF-D2423BWR | Ø2.4 мм x 2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |

## Одноразовые щипцы для биопсии (овальные бранши, с иглой, с тефлоном)

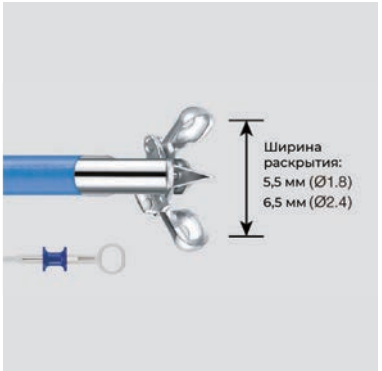


| Артикул (не вращающ.) | Артикул (вращающ.) | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|---|
| AF-D1810BWC | AF-D1810BWCR | Ø1.8мм x 1000 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-D1812BWC | AF-D1812BWCR | Ø1.8мм x 1200 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-D1816BWC | AF-D1816BWCR | Ø1.8мм x 1600 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-D2416BWC | AF-D2416BWCR | Ø2.4мм x 1600 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2418BWC | AF-D2418BWCR | Ø2.4 мм x 1800 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2421BWC | AF-D2421BWCR | Ø2.4 мм x 2100 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-D2423BWC | AF-D2423BWCR | Ø2.4 мм x 2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |

## Одноразовые щипцы для биопсии (бранши типа «Аллигатор», с иглой)

| Артикул (не вращающ.) | Артикул (вращающ.) | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|---|
| AF-D1810BZ | AF-D1810BZR | Ø1.8мм x 1000 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-D1812BZ | AF-D1812BZR | Ø1.8мм x 1200 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-D1816BZ | AF-D1816BZR | Ø1.8мм x 1600 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-D2416BZ | AF-D2416BZR | Ø2.4мм x 1600 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2418BZ | AF-D2418BZR | Ø2.4 мм x 1800 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2421BZ | AF-D2421BZR | Ø2.4 мм x 2100 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-D2423BZ | AF-D2423BZR | Ø2.4 мм x 2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |





## Одноразовые щипцы для биопсии (бранши типа «Аллигатор», с иглой, с тефлоном)

| Артикул (не вращающ.) | Артикул (вращающ.) | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|---|
| AF-D1810BZC | AF-D1810BZCR | Ø1.8мм x 1000 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-D1812BZC | AF-D1812BZCR | Ø1.8мм x 1200 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-D1816BZC | AF-D1816BZCR | Ø1.8мм x 1600 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-D2416BZC | AF-D2416BZCR | Ø2.4мм x 1600 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2418BZC | AF-D2418BZCR | Ø2.4 мм x 1800 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2421BZC | AF-D2421BZCR | Ø2.4 мм x 2100 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-D2423BZC | AF-D2423BZCR | Ø2.4 мм x 2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |



# Одноразовые щипцы для удаления инородных тел



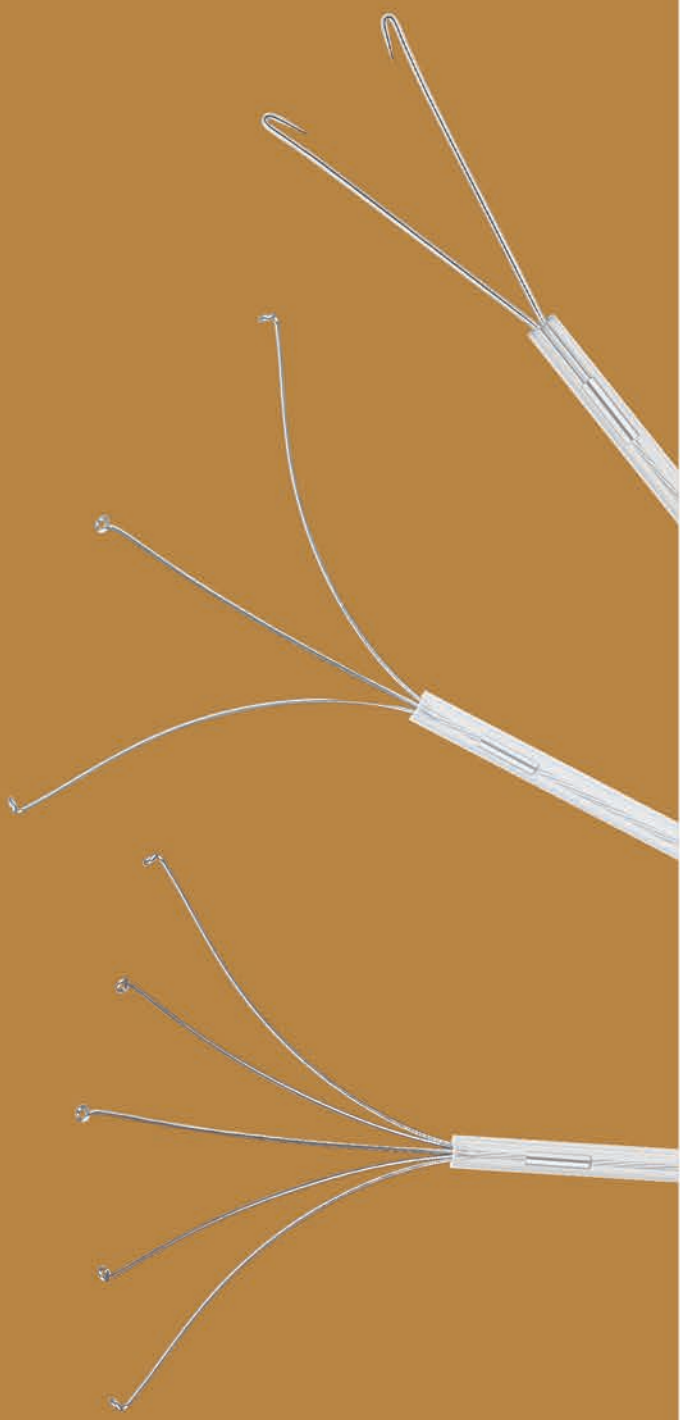

## Одноразовые захватывающие щипцы (тип «Крысиный зуб»)

| Артикул (не вращающиеся) | Артикул (вращающиеся) | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|---|
| AF-D1007GI | AF-D1007GIR | Ø1.0x700 мм | ≥Ø1.2 мм | Урология |
| AF-D1010GI | AF-D1010GIR | Ø1.0x1000 мм | ≥Ø1.2 мм | Урология |
| AF-D1012GI | AF-D1012GIR | Ø1.0x1200 мм | ≥Ø1.2 мм | Урология |
| AF-D1810GI | AF-D1810GIR | Ø1.8x1000 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-D1812GI | AF-D1812GIR | Ø1.8x1200 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-D1816GI | AF-D1816GIR | Ø1.8x1600 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-D1825GI | AF-D1825GIR | Ø1.8x2500 мм | ≥Ø2.0 мм | Энтероскопия |
| AF-D2416GI | AF-D2416GIR | Ø2.4x1600 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2418GI | AF-D2418GIR | Ø2.4x1800 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2421GI | AF-D2421GIR | Ø2.4x2100 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-D2423GI | AF-D2423GIR | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |

Ширина раскрытия:
4мм(Ø1.0)
5мм(Ø1.8) 7мм(Ø2.4)



## Одноразовые захватывающие щипцы (тип «Крысиный зуб» и бранши «Аллигатор»)

| Артикул (не вращающиеся) | Артикул (вращающиеся) | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|---|
| AF-D1810GJ | AF-D1810GJR | Ø1.8x1000 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-D1812GJ | AF-D1812GJR | Ø1.8x1200 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-D1816GJ | AF-D1816GJR | Ø1.8x1600 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-D1825GJ | AF-D1825GJR | Ø1.8x2500 мм | ≥Ø2.0 мм | Энтероскопия |
| AF-D2416GJ | AF-D2416GJR | Ø2.4x1600 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2418GJ | AF-D2418GJR | Ø2.4x1800 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2421GJ | AF-D2421GJR | Ø2.4x2100 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-D2423GJ | AF-D2423GJR | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |

Ширина раскрытия:
5.5мм(Ø1.8) 8мм(Ø2.4)



## Одноразовые захватывающие щипцы (тип «Аллигатор»)

| Артикул (не вращающиеся) | Артикул (вращающиеся) | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|---|
| AF-D1810GH | AF-D1810GHR | Ø1.8x1000 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-D1812GH | AF-D1812GHR | Ø1.8x1200 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-D1816GH | AF-D1816GHR | Ø1.8x1600 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-D1825GH | AF-D1825GHR | Ø1.8x2500 мм | ≥Ø2.0 мм | Энтероскопия |
| AF-D2416GH | AF-D2416GHR | Ø2.4x1600 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2418GH | AF-D2418GHR | Ø2.4x1800 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2421GH | AF-D2421GHR | Ø2.4x2100 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-D2423GH | AF-D2423GHR | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |

Ширина раскрытия:
7.5мм(Ø1.8) 8.5мм(Ø2.4)



## Одноразовые захватывающие щипцы (тип «Пеликан»)




| Артикул (не вращающиеся) | Артикул (вращающиеся) | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|---|
| AF-D1810GK | AF-D1810GKR | Ø1.8x1000 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-D1812GK | AF-D1812GKR | Ø1.8x1200 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-D1816GK | AF-D1816GKR | Ø1.8x1600 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-D1825GK | AF-D1825GKR | Ø1.8x2500 мм | ≥Ø2.0 мм | Энтероскопия |
| AF-D2416GK | AF-D2416GKR | Ø2.4x1600 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2418GK | AF-D2418GKR | Ø2.4x1800 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2421GK | AF-D2421GKR | Ø2.4x2100 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-D2423GK | AF-D2423GKR | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |

## Одноразовые захватывающие щипцы (с 5 зубцами)



| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-D1807GM105 | Ø1.8x700 мм | ≥Ø2.0 мм | Холедоскопия |
| AF-D1810GM105 | Ø1.8x1000 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-D1815GM105 | Ø1.8x1500 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-D1825GM105 | Ø1.8x2500 мм | ≥Ø2.0 мм | Энтероскопия |
| AF-D2416GM105 | Ø2.4x1600 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2417GM105 | Ø2.4x1700 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2421GM105 | Ø2.4x2100 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-D2423GM105 | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |


## Одноразовые захватывающие щипцы (с 5 крючками)



| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-D1007GM105-H | Ø1.0x700 мм | ≥Ø1.2 мм | Урология |
| AF-D1010GM105-H | Ø1.0x1000 мм | ≥Ø1.2 мм | Урология |
| AF-D1012GM105-H | Ø1.0x1200 мм | ≥Ø1.2 мм | Урология |
| AF-D1807GM105-H | Ø1.8x700 мм | ≥Ø2.0 мм | Холедоскопия |
| AF-D1810GM105-H | Ø1.8x1000 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-D1815GM105-H | Ø1.8x1500 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-D1825GM105-H | Ø1.8x2500 мм | ≥Ø2.0 мм | Энтероскопия |
| AF-D2416GM105-H | Ø2.4x1600 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2417GM105-H | Ø2.4x1700 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2421GM105-H | Ø2.4x2100 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-D2423GM105-H | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |

## Одноразовые захватывающие щипцы (с 3 зубцами)

| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-D1807GM103 | Ø1.8x700 мм | ≥Ø2.0 мм | Холедоскопия |
| AF-D1810GM103 | Ø1.8x100 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-D1815GM103 | Ø1.8x150 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-D1825GM103 | Ø1.8x250 мм | ≥Ø2.0 мм | Энтероскопия |
| AF-D2416GM103 | Ø2.4x160 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2417GM103 | Ø2.4x170 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2421GM103 | Ø2.4x210 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-D2423GM103 | Ø2.4x230 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |

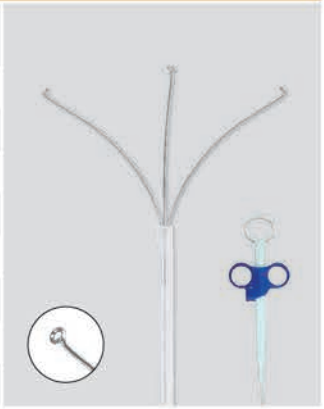

## Одноразовые захватывающие щипцы (с 3 крючками)

| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-D1007GM103-H | Ø1.0x700 мм | ≥Ø1.2 мм | Урология |
| AF-D1010GM103-H | Ø1.0x1000 мм | ≥Ø1.2 мм | Урология |
| AF-D1012GM103-H | Ø1.0x1200 мм | ≥Ø1.2 мм | Урология |
| AF-D1807GM103-H | Ø1.8x700 мм | ≥Ø2.0 мм | Холедоскопия |
| AF-D1810GM103-H | Ø1.8x1000 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-D1815GM103-H | Ø1.8x1500 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-D1825GM103-H | Ø1.8x2500 мм | ≥Ø2.0 мм | Энтероскопия |
| AF-D2416GM103-H | Ø2.4x1600 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2417GM103-H | Ø2.4x1700 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2421GM103-H | Ø2.4x2100 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-D2423GM103-H | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |




## Одноразовые захватывающие щипцы (с 2 зубцами)

| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-D1825GM102 | Ø1.8x2500 мм | ≥Ø2.0 мм | Энтероскопия |
| AF-D2416GM102 | Ø2.4x1600 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2417GM102 | Ø2.4x1700 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2421GM102 | Ø2.4x2100 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-D2423GM102 | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |



# Одноразовые захватывающие и извлекающие корзины

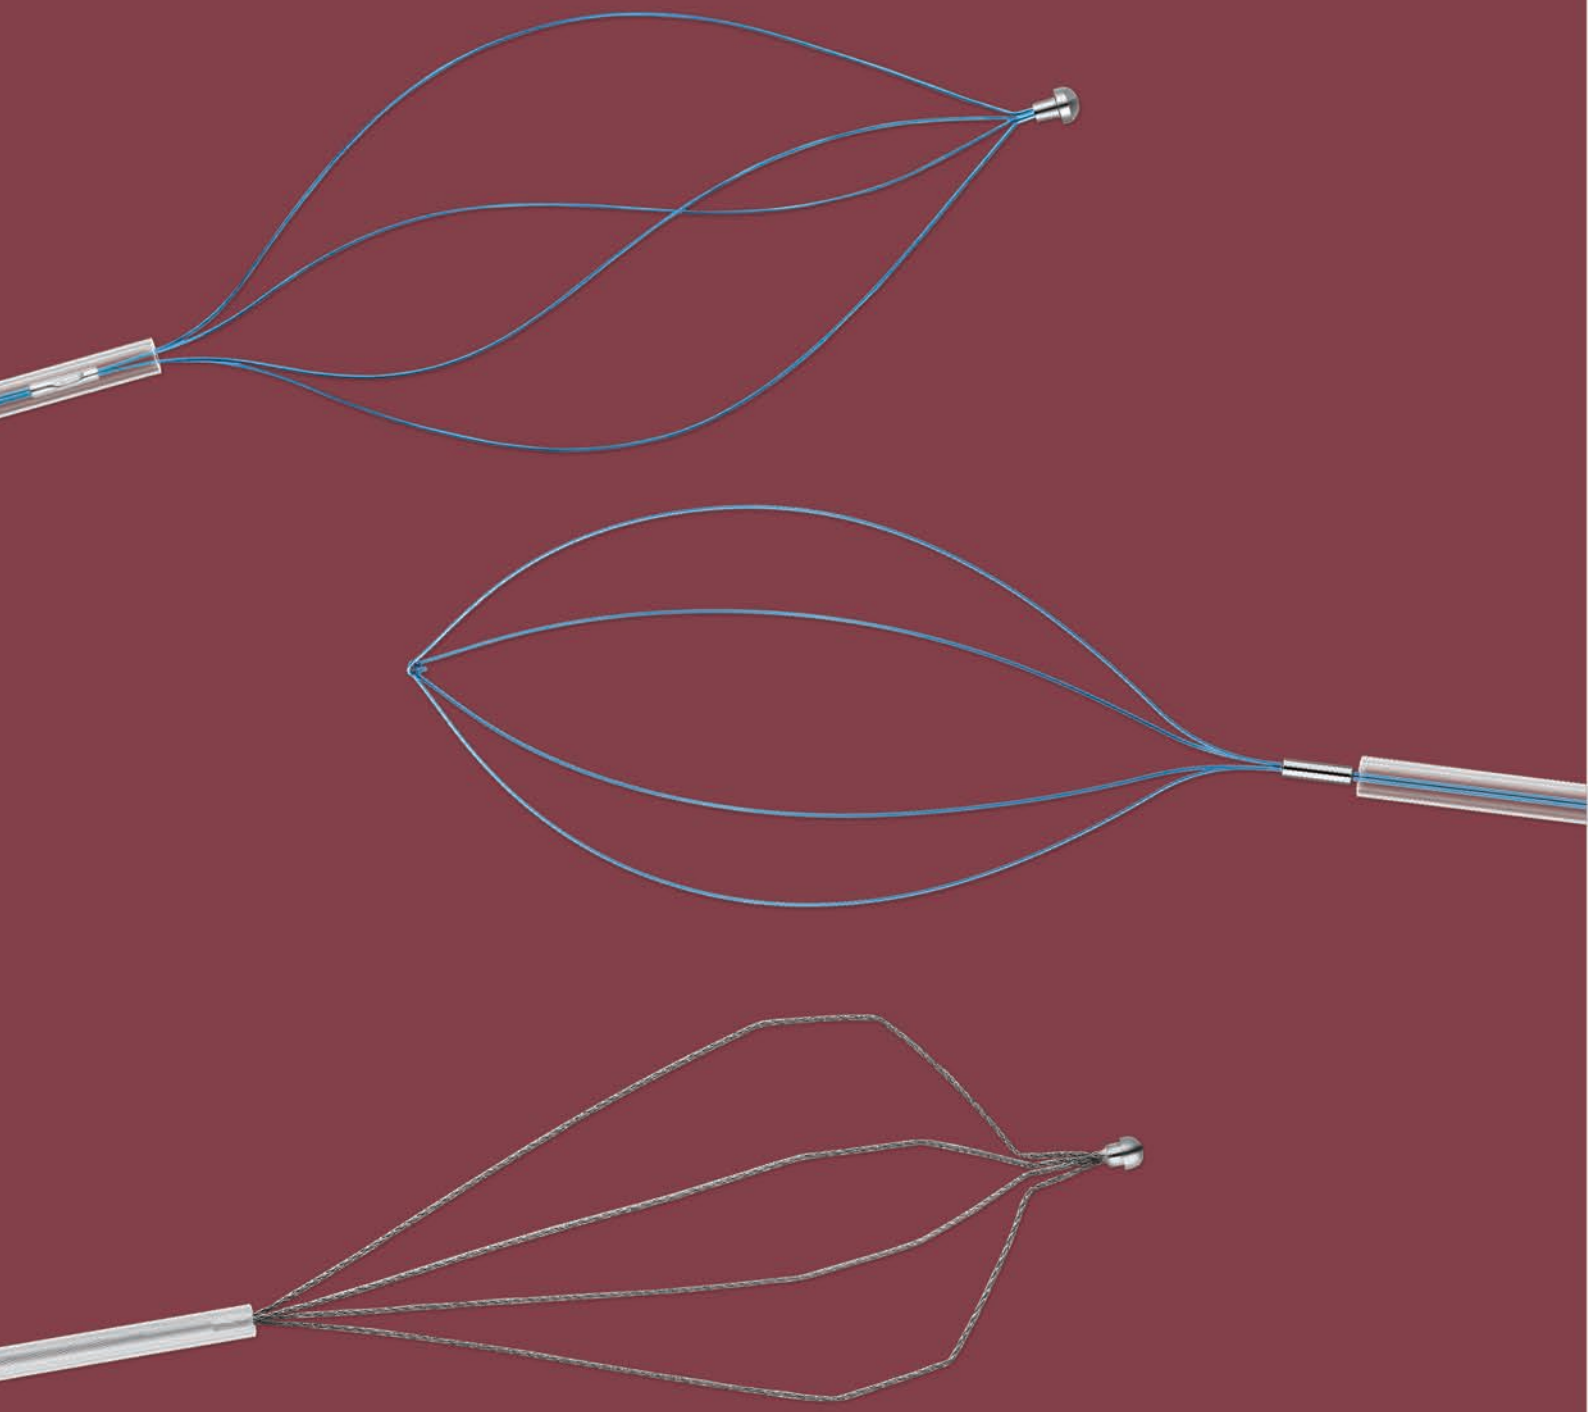

## Одноразовая корзина для извлечения (гексагонального типа)

| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-D1807GL0 | Ø1.8x700 мм | ≥Ø2.0 мм | Холедоскопия |
| AF-D1810GL0 | Ø1.8x1000 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-D1816GL0 | Ø1.8x1600 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-D1825GL0 | Ø1.8x2500 мм | ≥Ø2.0 мм | Энтероскопия |
| AF-D2415GL0 | Ø2.4x1500 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2417GL0 | Ø2.4x1700 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2421GL0 | Ø2.4x2100 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-D2423GL0 | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |

Ширина раскрытия:
10/15/20мм(Ø1.8)
10/15/20/25/30/35мм(Ø2.4)



Для извлечения круглых и скользких объектов.

## Одноразовая корзина для извлечения (овального типа)

| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-D1007GL1 | Ø1.0x700 мм | ≥Ø1.2 мм | Урология |
| AF-D1010GL1 | Ø1.0x1000 мм | ≥Ø1.2 мм | Урология |
| AF-D1012GL1 | Ø1.0x1200 мм | ≥Ø1.2 мм | Урология |
| AF-D1807GL1 | Ø1.8x700 мм | ≥Ø2.0 мм | Холедоскопия |
| AF-D1810GL1 | Ø1.8x1000 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-D1816GL1 | Ø1.8x1600 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-D1825GL1 | Ø1.8x2500 мм | ≥Ø2.0 мм | Энтероскопия |
| AF-D2415GL1 | Ø2.4x1500 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2417GL1 | Ø2.4x1700 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2421GL1 | Ø2.4x2100 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-D2423GL1 | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |

Ширина раскрытия:
10/15мм(Ø1.0)
10/15/20мм(Ø1.8)
10/15/20/25/30/35мм(Ø2.4)



Для извлечения круглых и скользких объектов.

## Одноразовая корзина для извлечения (спиралевидного типа)

| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-D1007GL2 | Ø1.0x700 мм | ≥Ø1.2 мм | Урология |
| AF-D1010GL2 | Ø1.0x1000 мм | ≥Ø1.2 мм | Урология |
| AF-D1012GL2 | Ø1.0x1200 мм | ≥Ø1.2 мм | Урология |
| AF-D1807GL2 | Ø1.8x700 мм | ≥Ø2.0 мм | Холедоскопия |
| AF-D1810GL2 | Ø1.8x1000 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-D1816GL2 | Ø1.8x1600 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-D1825GL2 | Ø1.8x2500 мм | ≥Ø2.0 мм | Энтероскопия |
| AF-D2415GL2 | Ø2.4x1500 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2417GL2 | Ø2.4x1700 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2421GL2 | Ø2.4x2100 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-D2423GL2 | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |

Ширина раскрытия:
10/15мм(Ø1.0)
10/15/20мм(Ø1.8)
10/15/20/25/30/35мм(Ø2.4)



Для извлечения круглых и скользких объектов.

# Одноразовые принадлежности
















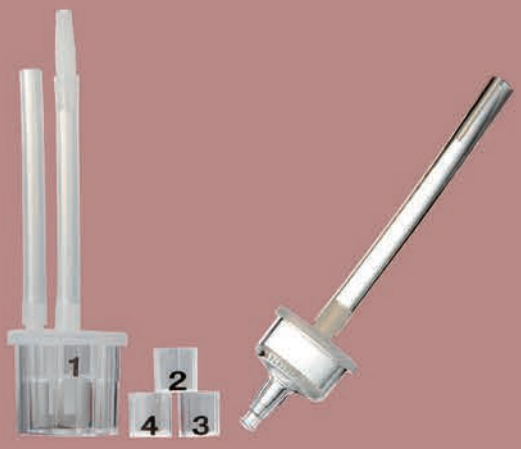

## Одноразовый спрей-катетер (стандартный тип)

| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-D1810PA | Ø1.8x1000мм | ≥Ø2.0мм | Бронхоскопия |
| AF-D1812PA | Ø1.8x1200мм | ≥Ø2.0мм | Бронхоскопия |
| AF-D1816PA | Ø1.8x1600мм | ≥Ø2.0мм | Гастроскопия |
| AF-D2416PA | Ø2.4x1600мм | ≥Ø2.8мм | Гастроскопия |
| AF-D2418PA | Ø2.4x1800мм | ≥Ø2.8мм | Гастроскопия |
| AF-D2421PA | Ø2.4x2100мм | ≥Ø2.8мм | Колоноскопия |
| AF-D2423PA | Ø2.4x2300мм | ≥Ø2.8мм | Колоноскопия |



## Одноразовый спрей-катетер (распыление тумана)

| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-D1810PB | Ø1.8x1000мм | ≥Ø2.0мм | Бронхоскопия |
| AF-D1812PB | Ø1.8x1200мм | ≥Ø2.0мм | Бронхоскопия |
| AF-D1816PB | Ø1.8x1600мм | ≥Ø2.0мм | Гастроскопия |
| AF-D2416PB | Ø2.4x1600мм | ≥Ø2.8мм | Гастроскопия |
| AF-D2418PB | Ø2.4x1800мм | ≥Ø2.8мм | Гастроскопия |
| AF-D2421PB | Ø2.4x2100мм | ≥Ø2.8мм | Колоноскопия |
| AF-D2423PB | Ø2.4x2300мм | ≥Ø2.8мм | Колоноскопия |



## Одноразовая цитологическая щетка (прямая)




| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-D1810WB | Ø1.8x1000 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-D1812WB | Ø1.8x1200 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-D1816WB | Ø1.8x1600 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-D2416WB | Ø2.4x1600 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2423WB | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |

## Одноразовая цитологическая щетка (U-образного типа)





| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-D1810WB-C | Ø1.8x1000 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-D1812WB-C | Ø1.8x1200 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-D1816WB-C | Ø1.8x1600 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-D2416WB-C | Ø2.4x1600 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2423WB-C | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |

## Одноразовая щетка для чистки (одинарный наконечник)




| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-D1012WAS | Ø1.0x1200 мм | ≥Ø1.2 мм | Урология |
| AF-D1022WAS | Ø1.0x2200 мм | ≥Ø1.2 мм | Урология |
| AF-D1818WAS | Ø1.8x1800 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-D2416WAS | Ø2.4x1600 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2422WAS | Ø2.4x2200 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |

## Одноразовая щетка для чистки (двойной наконечник)

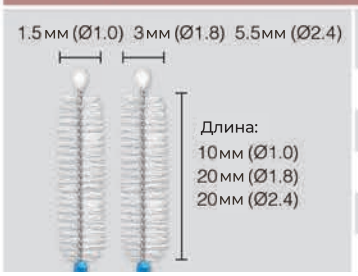


| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-D1012WA | Ø1.0x1200 мм | ≥Ø1.2 мм | Урология |
| AF-D1022WA | Ø1.0x2200 мм | ≥Ø1.2 мм | Урология |
| AF-D1818WA | Ø1.8x1800 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-D2416WA | Ø2.4x1600 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2422WA | Ø2.4x2200 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |

## Одноразовая щетка для чистки (двухсторонняя, одна сторона больше другой)





| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-D1818WAV | Ø1.8x1800 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-D2416WAV | Ø2.4x1600 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-D2422WAV | Ø2.4x2200 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |

## Одноразовые щетки для чистки отверстий портов


| Наименование | Артикул |
|---|---|
| Клапанная щетка | AF-D1001WCR |




| Наименование | Артикул |
|---|---|
| Щетка для чистки отверстий | AF-D1001WC |




| Наименование | Артикул |
|---|---|
| Щетка для чистки отверстий | AF-D1001WR |




## Одноразовые блокираторы для прикуса



| Наименование | Артикул |
|---|---|
| Фиксатор прикуса для взрослых (с эластичной лентой) | AF-GBW |



| Наименование | Артикул |
|---|---|
| Фиксатор прикуса для взрослых | AF-GB |



| Наименование | Артикул |
|---|---|
| Фиксатор прикуса для детей (на резинке) | AF-GBW-C |



| Наименование | Артикул |
|---|---|
| Фиксатор прикуса при отсутсвии зубов (с эластичной лентой) | AF-GBW-N |



| Наименование | Артикул |
|---|---|
| Фиксатор прикуса при отсутсвия зубов | AF-GB-N |

## Одноразовые ловушки для полипов




| Наименование | Артикул |
|---|---|
| Захватчик полипов (4 камеры) | AF-DPT |

Забор образца осуществляется с помощью аспиратора с отрицательным давлением, а отработанная жидкость отсасывается автоматически.
С помощью этого устройства можно взять образцы у четырех пациентов.
Четыре контейнера для образцов маркированы и могут быть разобраны независимо одруг от друга для эффективного предотвращения загрязнения образцов.



| Наименование | Артикул |
|---|---|
| Захватчик полипов (1 камера) | AF-DPT-S |

Забор образца осуществляется с помощью аспиратора с отрицательным давлением, а отработанная жидкость отсасывается автоматически.
С помощью этого устройства можно взять образец у одного пациента.
Контейнер для образцов прозрачен. Его легко использовать для наблюдения за состоянием образца, эффективно предотвращает загрязнение образца.

## Набор одноразовых клапанов для эндоскопа



| Наименование | Артикул | OLYMPUS |
|---|---|---|
| Набор одноразовых клапанов для эндоскопа (для OLYMPUS) | AF-DVS3-O | GIF-H290/260 CF-H290/260 PCF-H290/260 series |



| Наименование | Артикул | OLYMPUS |
|---|---|---|
| Набор одноразовых клапанов для эндоскопа (для OLYMPUS) | AF-DVS4-O | GIF-H290/260 CF-H290/260 PCF-H290/260 series |



| Наименование | Артикул | FUJIFILM |
|---|---|---|
| Набор одноразовых клапанов для эндоскопа (для FUJIFILM) | AF-DVS3-F | EC-L600/590/580 EG-L600/590/580 series |



| Наименование | Артикул | FUJIFILM |
|---|---|---|
| Набор одноразовых клапанов для эндоскопа (для FUJIFILM) | AF-DVS4-F | EC-L600/590/580 EG-L600/590/580 series |



| Наименование | Артикул | PENTAX |
|---|---|---|
| Набор одноразовых клапанов для эндоскопа (для PENTAX) | AF-DVS3-P | i10/90i series |




| Наименование | Артикул | PENTAX |
|---|---|---|
| Набор одноразовых клапанов для эндоскопа (для PENTAX) | AF-DVS4-P | i10/90i series |



| Наименование | Артикул | |
|---|---|---|
| Крышка клапана | AF-BVC-O | OLYMPUS |
| | AF-BVC-F | FUJIFILM |
| | AF-BVC-P | PENTAX |

## Эндоскопическое дистальное крепление


| | Артикул | Диаметр | OLYMPUS | FUJIFILM | PENTAX |
|---|---|---|---|---|---|
|  Прямое | AF-D09904AC1 | Ø9.9 мм | PCF-H290/260, GIF-H290/260 | EG-L600ZW7, EG-L580RD7 | EG29-i10, EG29-i10N |
| | AF-D10804AC1 | Ø10.8 мм | CF-EZ1500 | EG-L590ZW | ———— |
| | AF-D12804AC1 | Ø12.8 мм | CF-H290, PCF-H290ZL/I CF-H170L/I | EC-L600ZP7, EC-720R/M EC760R-V/M | EC34-i10M, EC34-i10L EC34-i10F |
| | AF-D13204AC1 | Ø13.2 мм | CF-EZ1500DL/I | ———— | EC38-i10L, EC38-i10F/F2 EC38-i10M/M2 |
|  Прямое с отверстием | Артикул | Диаметр | OLYMPUS | FUJIFILM | PENTAX |
| | AF-D09904AC2 | Ø9.9 мм | PCF-H290/260, GIF-H290/260 | EG-L600ZW7, EG-L580RD7 | EG29-i10, EG29-i10N |
| | AF-D10804AC2 | Ø10.8 мм | CF-EZ1500 | EG-L590ZW | ———— |
| | AF-D12804AC2 | Ø12.8 мм | CF-H290, PCF-H290ZL/I CF-H170L/I | EC-L600ZP7, EC-720R/M EC760R-V/M | EC34-i10M, EC34-i10L EC34-i10F |
| | AF-D13204AC2 | Ø13.2 мм | CF-EZ1500DL/I | ———— | EC38-i10L, EC38-i10F/F2 EC38-i10M/M2 |
|  Скошенное | Артикул | Диаметр | OLYMPUS | FUJIFILM | PENTAX |
| | AF-D09904AC3 | Ø9.9 мм | PCF-H290/260, GIF-H290/260 | EG-L600ZW7, EG-L580RD7 | EG29-i10, EG29-i10N |
| | AF-D10804AC3 | Ø10.8 мм | CF-EZ1500 | EG-L590ZW | ———— |
| | AF-D12804AC3 | Ø12.8 мм | CF-H290, PCF-H290ZL/I CF-H170L/I | EC-L600ZP7, EC-720R/M EC760R-V/M | EC34-i10M, EC34-i10L EC34-i10F |
| | AF-D13204AC3 | Ø13.2 мм | CF-EZ1500DL/I | ———— | EC38-i10L, EC38-i10F/F2 EC38-i10M/M2 |
|  Скошенное с отверстием | Артикул | Диаметр | OLYMPUS | FUJIFILM | PENTAX |
| | AF-D09904AC4 | Ø9.9 мм | PCF-H290/260, GIF-H290/260 | EG-L600ZW7, EG-L580RD7 | EG29-i10, EG29-i10N |
| | AF-D10804AC4 | Ø10.8 мм | CF-EZ1500 | EG-L590ZW | ———— |
| | AF-D12804AC4 | Ø12.8 мм | CF-H290, PCF-H290ZL/I CF-H170L/I | EC-L600ZP7, EC-720R/M EC760R-V/M | EC34-i10M, EC34-i10L EC34-i10F |
| | AF-D13204AC4 | Ø13.2 мм | CF-EZ1500DL/I | ———— | EC38-i10L, EC38-i10F/F2 EC38-i10M/M2 |
|  Прямое с маркировкой | Артикул | Диаметр | OLYMPUS | FUJIFILM | PENTAX |
| | AF-D09904AC5 | Ø9.9 мм | PCF-H290/260, GIF-H290/260 | EG-L600ZW7, EG-L580RD7 | EG29-i10, EG29-i10N |
| | AF-D10804AC5 | Ø10.8 мм | CF-EZ1500 | EG-L590ZW | ———— |
| | AF-D12804AC5 | Ø12.8 мм | CF-H290, PCF-H290ZL/I CF-H170L/I | EC-L600ZP7, EC-720R/M EC760R-V/M | EC34-i10M, EC34-i10L EC34-i10F |
| | AF-D13204AC5 | Ø13.2 мм | CF-EZ1500DL/I | ———— | EC38-i10L, EC38-i10F/F2 EC38-i10M/M2 |
|  Прямое с отверстием, с маркировкой | Артикул | Диаметр | OLYMPUS | FUJIFILM | PENTAX |
| | AF-D09904AC6 | Ø9.9 мм | PCF-H290/260, GIF-H290/260 | EG-L600ZW7, EG-L580RD7 | EG29-i10, EG29-i10N |
| | AF-D10804AC6 | Ø10.8 мм | CF-EZ1500 | EG-L590ZW | ———— |
| | AF-D12804AC6 | Ø12.8 мм | CF-H290, PCF-H290ZL/I CF-H170L/I | EC-L600ZP7, EC-720R/M EC760R-V/M | EC34-i10M, EC34-i10L EC34-i10F |
| | AF-D13204AC6 | Ø13.2 мм | CF-EZ1500DL/I | ———— | EC38-i10L, EC38-i10F/F2 EC38-i10M/M2 |



**Диаметр:**

Внешний диаметр головного конца вводимой части эндоскопа.

# Многоразовые щипцы для биопсии

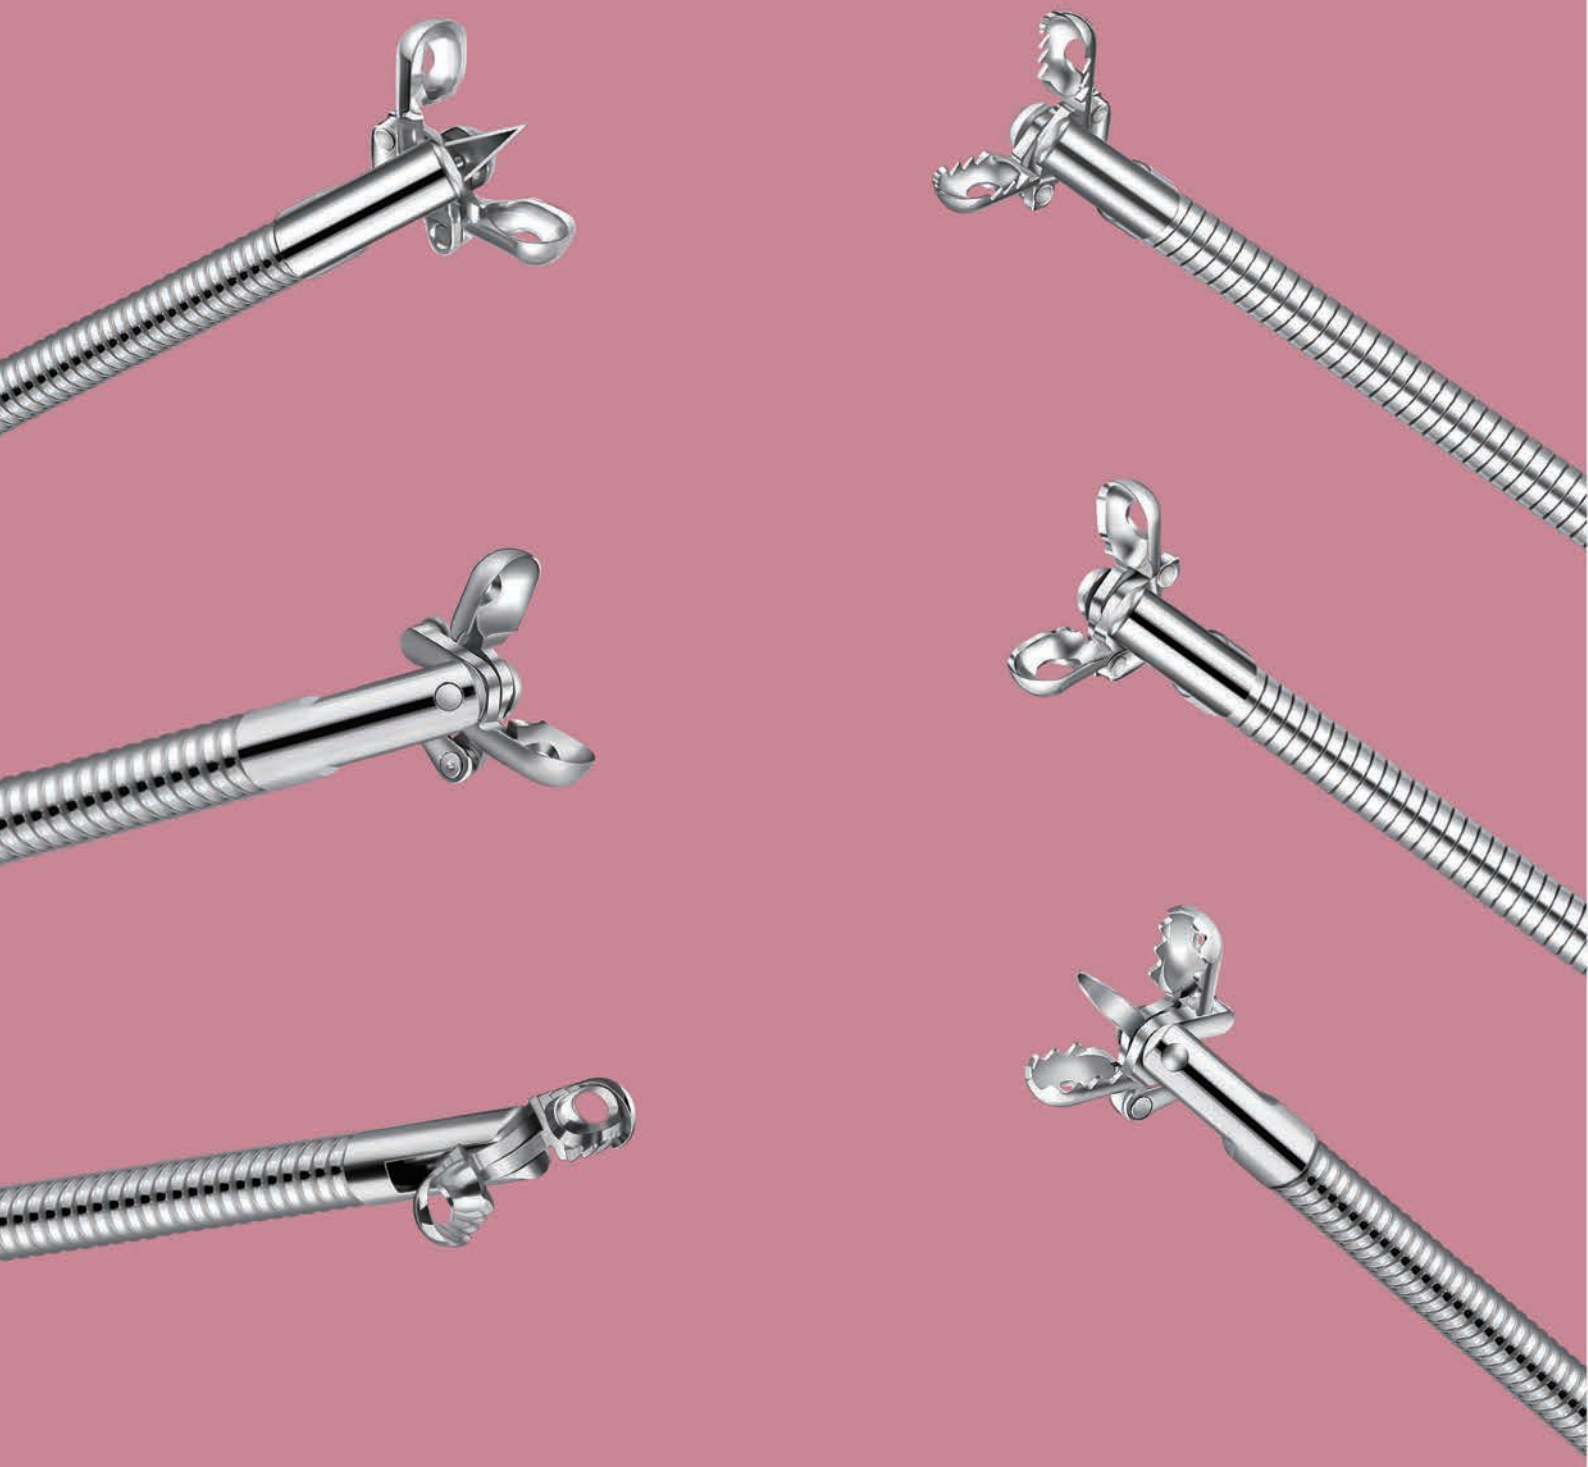

## Многоразовые щипцы для биопсии (овальные бранши с отверстиями)

AUTOCLAVABLE 132°C 270°F

| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-1807BT | Ø1.8x700 мм | ≥Ø2. мм | Холедоскопия |
| AF-1810BT | Ø1.8x1000 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-1815BT | Ø1.8x1500 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-1825BT | Ø1.8x2500 мм | ≥Ø2.0 мм | Энтероскопия |
| AF-2415BT | Ø2.4x1500 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2417BT | Ø2.4x1700 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2421BT | Ø2.4x2100 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-2423BT | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |

Ширина раскрытия:
5.5мм (Ø1.8) 6.5мм (Ø2.4)



Овальные и съемные бранши для более глубокой биопсии. Вращающиеся.

## Многоразовые щипцы для биопсии (стандартный тип)

AUTOCLAVABLE 132°C 270°F

| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-1807BS | Ø1.8x700 мм | ≥Ø2.0 мм | Холедоскопия |
| AF-1810BS | Ø1.8x1000 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-1815BS | Ø1.8x1500 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-1825BS | Ø1.8x2500 мм | ≥Ø2.0 мм | Энтероскопия |
| AF-2415BS | Ø2.4x1500 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2417BS | Ø2.4x1700 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2421BS | Ø2.4x2100 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-2423BS | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |

Ширина раскрытия:
5мм (Ø1.8) 6мм (Ø2.4)



Стандартные круглые бранши с отверстиями для минимизации повреждения тканей. Вращающиеся.

## Многоразовые щипцы для биопсии (овальные бранши с отверстиями и иглой)

AUTOCLAVABLE 132°C 270°F

| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-1807BW | Ø1.8x700 мм | ≥Ø2.0 мм | Холедоскопия |
| AF-1810BW | Ø1.8x100 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-1815BW | Ø1.8x150 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-1825BW | Ø1.8x250 мм | ≥Ø2.0 мм | Энтероскопия |
| AF-2415BW | Ø2.4x150 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2417BW | Ø2.4x170 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2421BW | Ø2.4x210 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-2423BW | Ø2.4x230 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |


Ширина раскрытия:
5.5мм (Ø1.8) 7мм (Ø2.4)



Овальные бранши с отверстиями и иглой для точной фиксации без скольжения. Минимизирует повреждение тканей. Вращающиеся.

## Многоразовые щипцы для биопсии (тип «Аллигатор», с одной подвижной браншей)

AUTOCLAVABLE 132°C 270°F

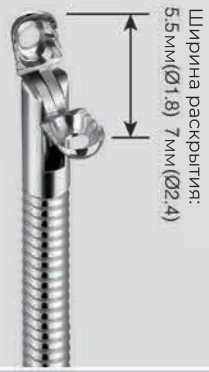


| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-1807BV | Ø1.8x700 мм | ≥Ø2.0 мм | Холедоскопия |
| AF-1810BV | Ø1.8x1000 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-1815BV | Ø1.8x1500 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-1825BV | Ø1.8x2500 мм | ≥Ø2.0 мм | Энтероскопия |
| AF-2415BV | Ø2.4x1500 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2417BV | Ø2.4x1700 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2421BV | Ø2.4x2100 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-2423BV | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |

Для глубокой биопсии твердых и труднодоступных тканей.

## Многоразовые щипцы для биопсии (тип «Аллигатор»)

AUTOCLAVABLE 132°C 270°F

Ширина раскрытия:
5.5мм(Ø1.8) 7мм(Ø2.4)



| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-1807BU | Ø1.8x700 мм | ≥Ø2.0 мм | Холедоскопия |
| AF-1810BU | Ø1.8x1000 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-1815BU | Ø1.8x1500 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-1825BU | Ø1.8x2500 мм | ≥Ø2.0 мм | Энтероскопия |
| AF-2415BU | Ø2.4x1500 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2417BU | Ø2.4x1700 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2421BU | Ø2.4x2100 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-2423BU | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |

Стандартные бранши для сбора твердых труднодоступных тканей. Вращающиеся.

## Многоразовые щипцы для биопсии (тип «Аллигатор» с иглой)

AUTOCLAVABLE 132°C 270°F


Ширина раскрытия:
5.5мм(Ø1.8) 7мм(Ø2.4)




| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-1807BWU | Ø1.8x700 мм | ≥Ø2.0 мм | Холедоскопия |
| AF-1810BWU | Ø1.8x1000 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-1815BWU | Ø1.8x1500 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-1825BWU | Ø1.8x2500 мм | ≥Ø2.0 мм | Энтероскопия |
| AF-2415BWU | Ø2.4x1500 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2417BWU | Ø2.4x1700 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2421BWU | Ø2.4x2100 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-2423BWU | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |

Стандартные бранши с иглой для точного прицеливания без скольжения. Для минимизации повреждения ткани. Вращающиеся.

# Многоразовые щипцы для удаления инородных тел

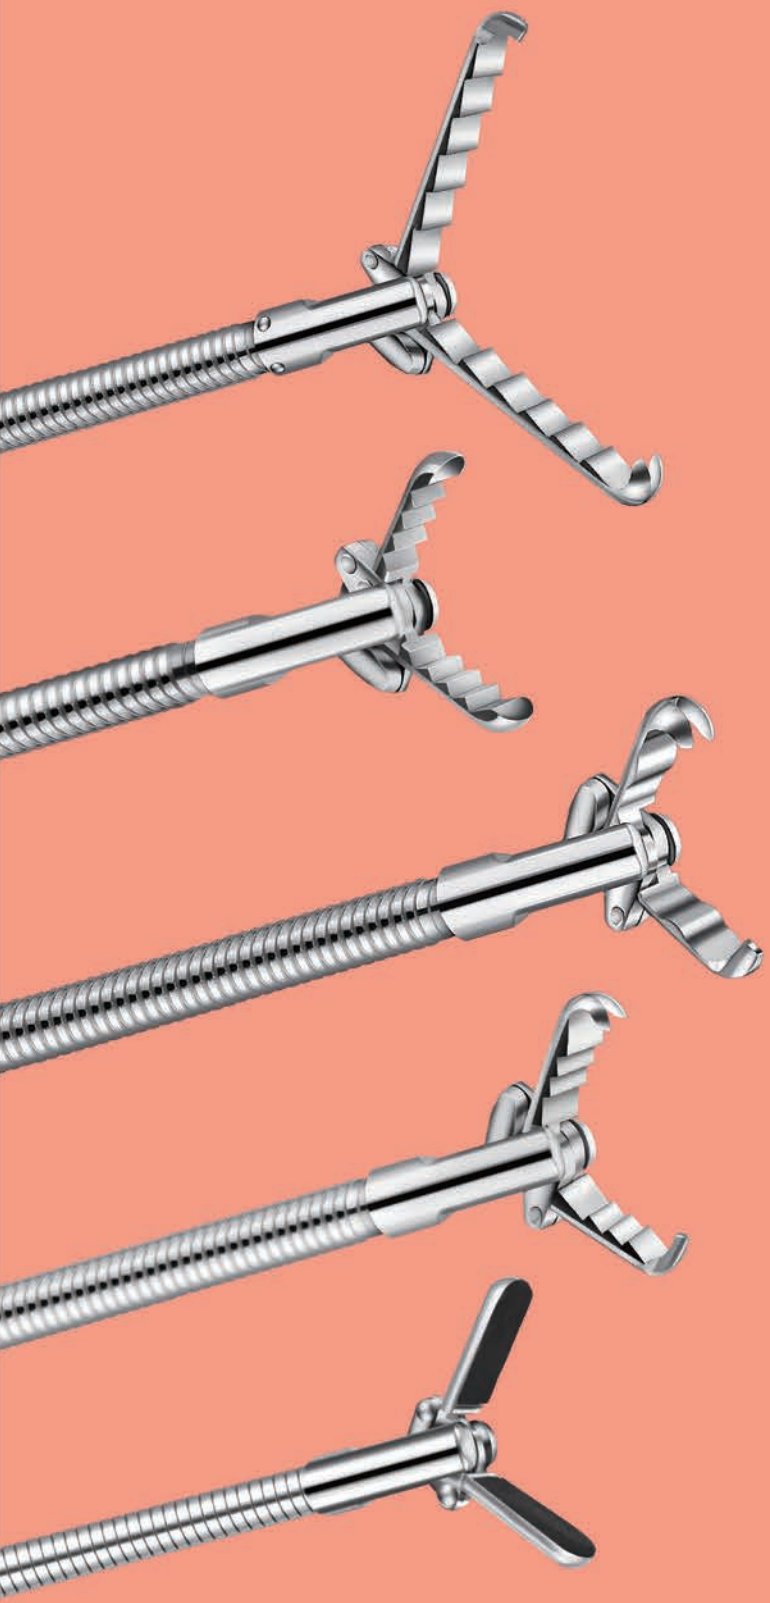

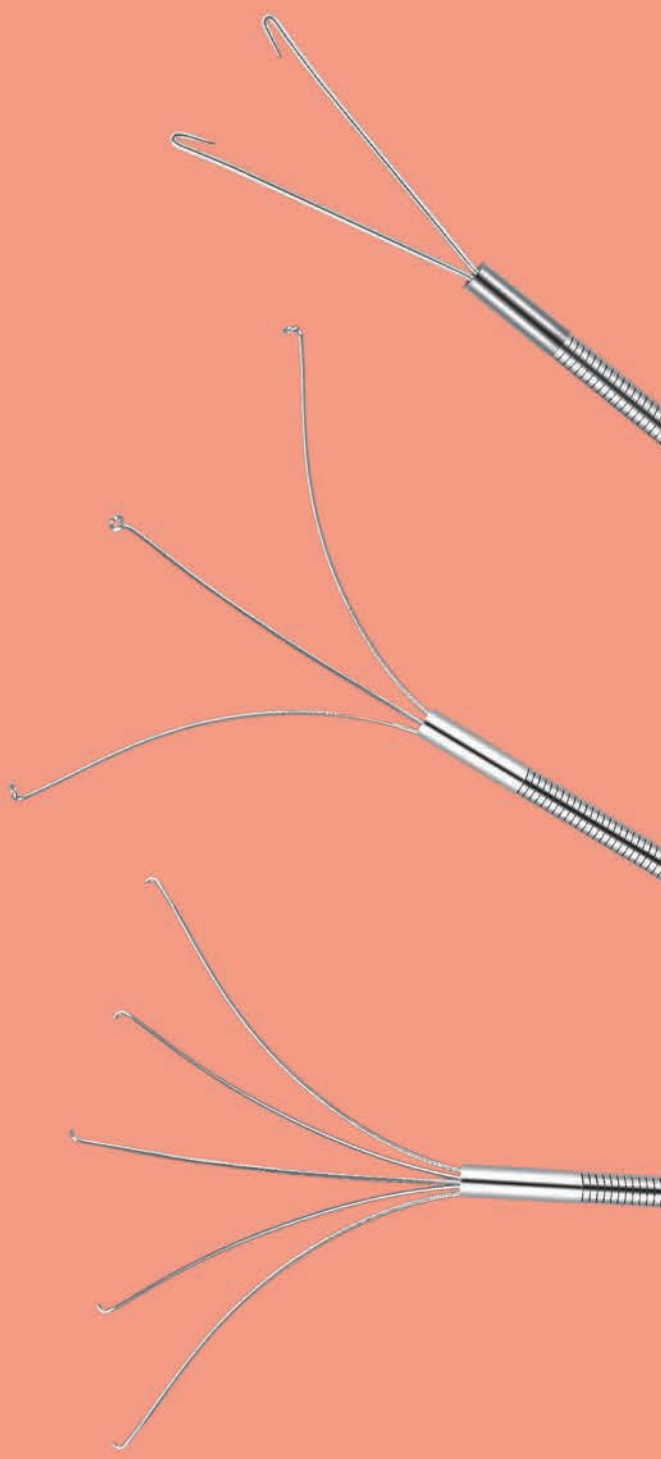

## Многоразовые захватывающие щипцы (тип «Крысиный зуб»)

AUTOCLAVABLE 132°C 270°F

Ширина раскрытия:
5мм(Ø1.8) 7мм(Ø2.4)



| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-1807GI | Ø1.8x700 мм | ≥Ø2.0 мм | Холедоскопия |
| AF-1810GI | Ø1.8x1000 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-1815GI | Ø1.8x1500 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-1825GI | Ø1.8x2500 мм | ≥Ø2.0 мм | Энтероскопия |
| AF-2415GI | Ø2.4x1500 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2417GI | Ø2.4x1700 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2421GI | Ø2.4x2100 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-2423GI | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |

Для извлечения плоских и твердых предметов.

## Многоразовые захватывающие щипцы (тип «Крысиный зуб» и бранши «Аллигатор»)

AUTOCLAVABLE 132°C 270°F

Ширина раскрытия:
5.5мм(Ø1.8) 6мм(Ø2.4)



| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-1807GJ | Ø1.8x700 мм | ≥Ø2.0 мм | Холедоскопия |
| AF-1810GJ | Ø1.8x100 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-1815GJ | Ø1.8x150 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-1825GJ | Ø1.8x250 мм | ≥Ø2.0 мм | Энтероскопия |
| AF-2415GJ | Ø2.4x150 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2417GJ | Ø2.4x170 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2421GJ | Ø2.4x210 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-2423GJ | Ø2.4x230 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |

Острый зуб, длинные бранши для извлечения плоских и твердых предметов при сложных ситуациях.

## Многоразовые захватывающие щипцы (тип «Аллигатор»)

AUTOCLAVABLE 132°C 270°F

Ширина раскрытия:
7мм(Ø1.8) 8.5мм(Ø2.4)




| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-1807GH | Ø1.8x700 мм | ≥Ø2.0 мм | Холедоскопия |
| AF-1810GH | Ø1.8x1000 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-1815GH | Ø1.8x1500 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-1825GH | Ø1.8x2500 мм | ≥Ø2.0 мм | Энтероскопия |
| AF-2415GH | Ø2.4x1500 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2417GH | Ø2.4x1700 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2421GH | Ø2.4x2100 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-2423GH | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |

Для предметов с острыми краями.

## Многоразовые захватывающие щипцы (тип «Пеликан»)

| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-1807GK | Ø1.8x700 мм | ≥Ø2.0 мм | Холедоскопия |
| AF-1810GK | Ø1.8x1000 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-1815GK | Ø1.8x1500 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-1825GK | Ø1.8x2500 мм | ≥Ø2.0 мм | Энтероскопия |
| AF-2415GK | Ø2.4x1500 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2417GK | Ø2.4x1700 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2421GK | Ø2.4x2100 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-2423GK | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |

Ширина раскрытия:
8мм(Ø1.8) 15мм(Ø2.4)

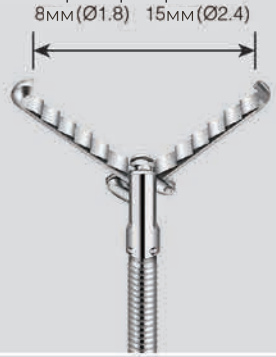


Для больших предметов.

## Многоразовые захватывающие щипцы (с резиновыми браншами)

| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-1810GM102-R | Ø1.8x1000 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-1815GM102-R | Ø1.8x1500 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-2415GM102-R | Ø2.4x1500 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2417GM102-R | Ø2.4x1700 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2421GM102-R | Ø2.4x2100 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-2423GM102-R | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |


Ширина раскрытия:
7мм(Ø1.8) 10мм(Ø2.4)



Резиновые наконечники для захвата скользких, плоских или острых мелких предметов.


## Многоразовые захватывающие щипцы (с 3 зубцами)

| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-1807GM103 | Ø1.8x700 мм | ≥Ø2.0 мм | Холедоскопия |
| AF-1810GM103 | Ø1.8x100 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-1815GM103 | Ø1.8x150 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-2416GM103 | Ø2.4x160 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2417GM103 | Ø2.4x170 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2421GM103 | Ø2.4x210 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-2423GM103 | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |

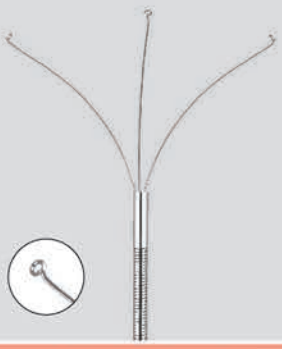


## Многоразовые захватывающие щипцы (с 3 крючками)

| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-1807GM103-H | Ø1.8x700 мм | ≥Ø2.0 мм | Холедоскопия |
| AF-1810GM103-H | Ø1.8x1000 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-1815GM103-H | Ø1.8x1500 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-2416GM103-H | Ø2.4x1600 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2417GM103-H | Ø2.4x1700 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2421GM103-H | Ø2.4x2100 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-2423GM103-H | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |

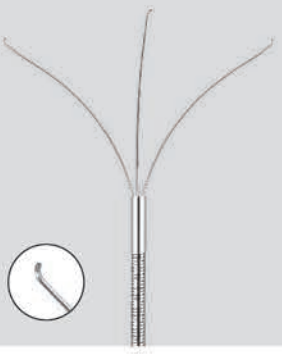

## Многоразовые захватывающие щипцы (с 5 зубцами)


AUTOCLAVABLE 132°C 270°F

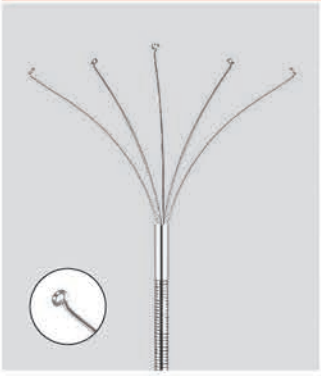

| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-1807GM105 | Ø1.8x700 мм | ≥Ø2.0 мм | Холедоскопия |
| AF-1810GM105 | Ø1.8x1000 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-1815GM105 | Ø1.8x1500 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-2416GM105 | Ø2.4x1600 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2417GM105 | Ø2.4x1700 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2421GM105 | Ø2.4x2100 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-2423GM105 | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |

## Многоразовые захватывающие щипцы (с 5 крючками)

AUTOCLAVABLE 132°C 270°F

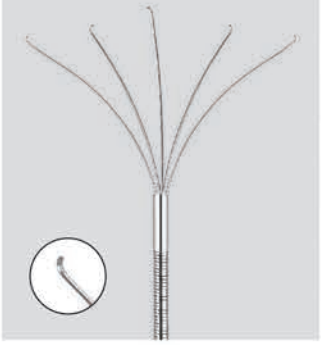

| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-1807GM105-H | Ø1.8x700 мм | ≥Ø2.0 мм | Холедоскопия |
| AF-1810GM105-H | Ø1.8x1000 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-1815GM105-H | Ø1.8x1500 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-2416GM105-H | Ø2.4x1600 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2417GM105-H | Ø2.4x1700 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2421GM105-H | Ø2.4x2100 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-2423GM105-H | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |


## Многоразовые захватывающие щипцы (с 2 зубцами)

AUTOCLAVABLE 132°C 270°F



| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-2416GZ102 | Ø2.4x1600 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2417GZ102 | Ø2.4x1700 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2421GZ102 | Ø2.4x2100 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-2423GZ102 | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |

# Многоразовые захватывающие корзины

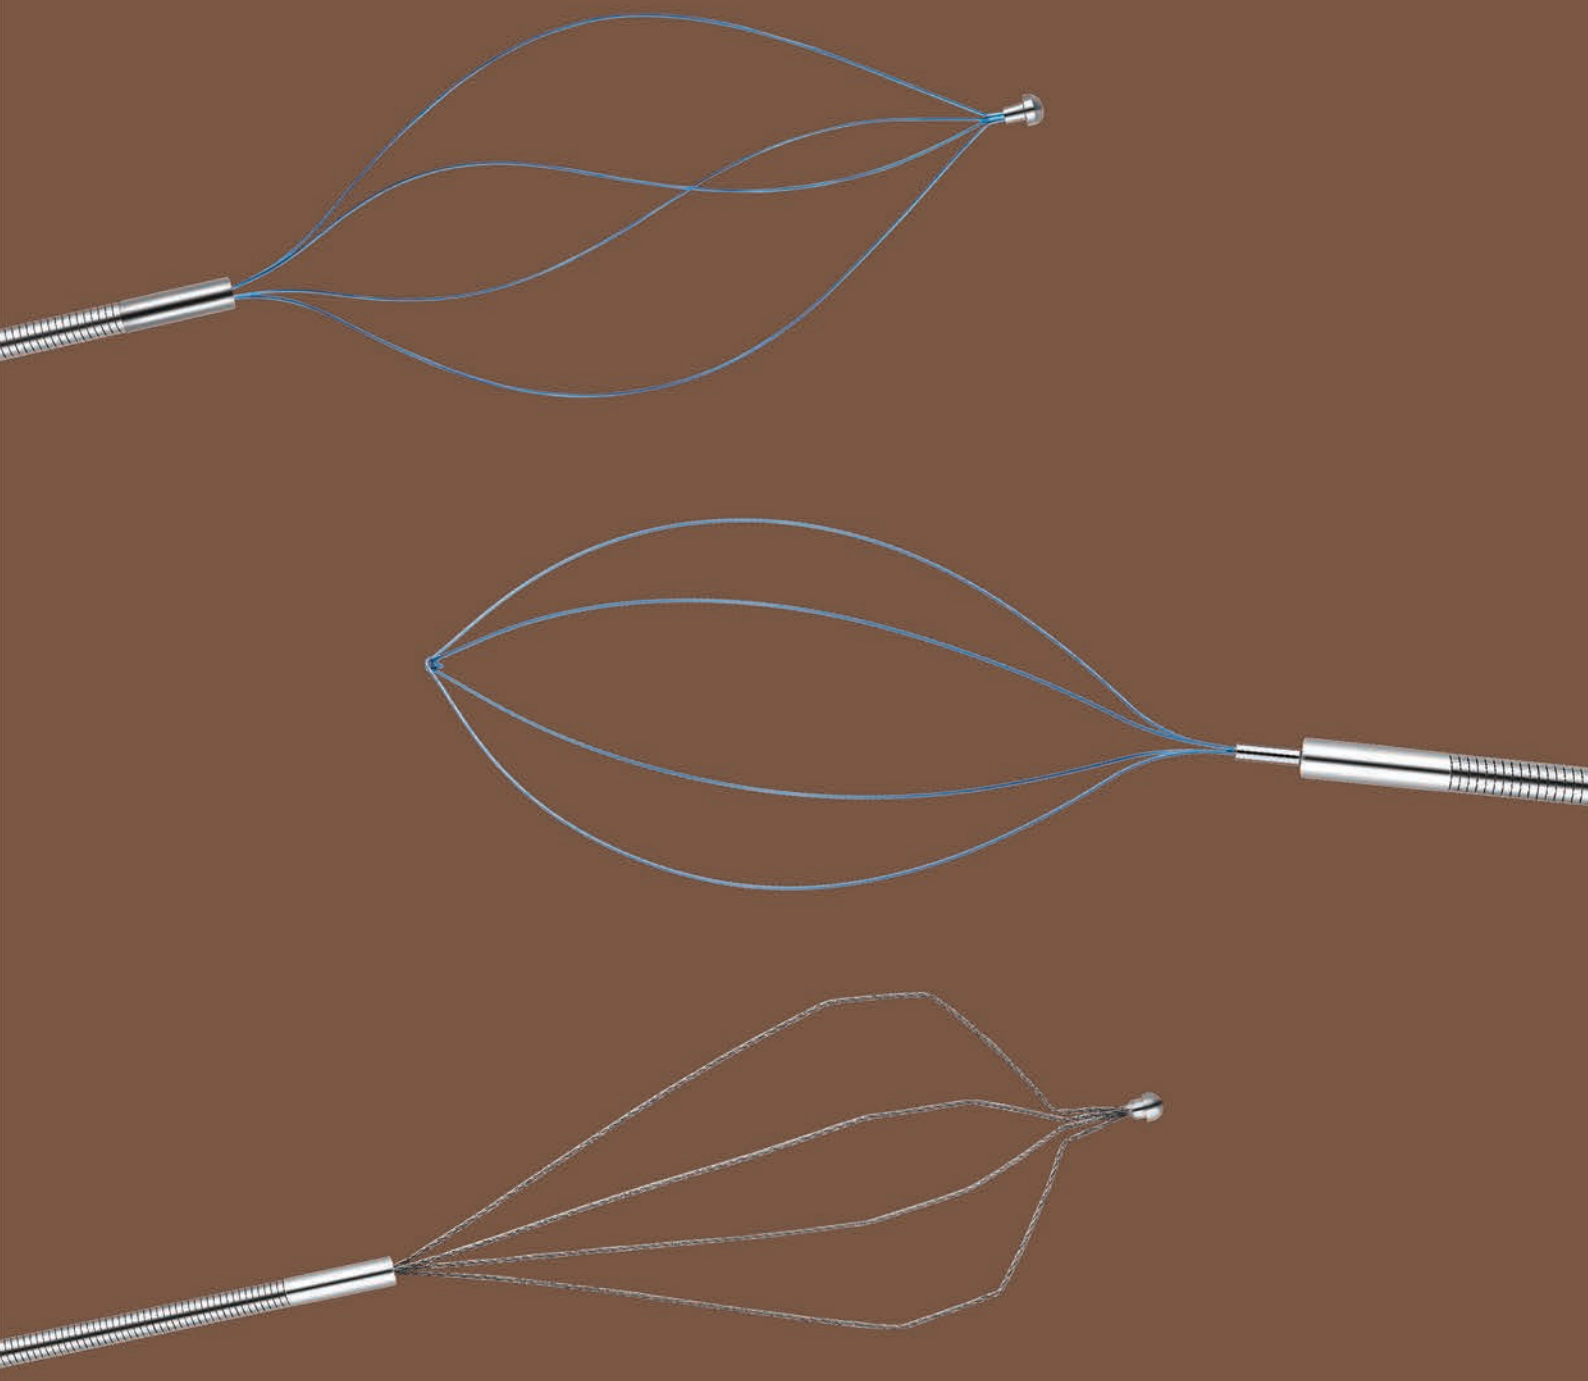

## Многоразовая корзина для извлечения (гексагонального типа, нержавеющая сталь)

AUTOCLAVABLE 132°C 270°F

Ширина раскрытия:
10/15/20 мм (Ø1.8)
10/15/20/25/30/35 мм (Ø2.4)



| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-1807GL0 | Ø1.8x700 мм | ≥Ø2.0 мм | Холедоскопия |
| AF-1810GL0 | Ø1.8x1000 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-1816GL0 | Ø1.8x1600 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-1825GL0 | Ø1.8x2500 мм | ≥Ø2.0 мм | Энтероскопия |
| AF-2415GL0 | Ø2.4x1500 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2417GL0 | Ø2.4x1700 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2421GL0 | Ø2.4x2100 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-2423GL0 | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |

Для извлечения круглых и сыпучих предметов.

## Многоразовая корзина для извлечения (овального типа, нитинол)

AUTOCLAVABLE 132°C 270°F

Ширина раскрытия:
10/15/20 мм (Ø1.8)
10/15/20/25/30/35 мм (Ø2.4)



| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-1807GL1 | Ø1.8x700 мм | ≥Ø2.0 мм | Холедоскопия |
| AF-1810GL1 | Ø1.8x1000 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-1816GL1 | Ø1.8x1600 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-1825GL1 | Ø1.8x2500 мм | ≥Ø2.0 мм | Энтероскопия |
| AF-2415GL1 | Ø2.4x1500 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2417GL1 | Ø2.4x1700 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2421GL1 | Ø2.4x2100 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-2423GL1 | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |

Для извлечения круглых и сыпучих предметов.

## Многоразовая выдвижная корзина (спиралевидного типа, нитинол)

AUTOCLAVABLE 132°C 270°F


Ширина раскрытия:
10/15/20 мм (Ø1.8)
10/15/20/25/30/35 мм (Ø2.4)



| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-1807GL2 | Ø1.8x700 мм | ≥Ø2.0 мм | Холедоскопия |
| AF-1810GL2 | Ø1.8x1000 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-1816GL2 | Ø1.8x1600 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-1825GL2 | Ø1.8x2500 мм | ≥Ø2.0 мм | Энтероскопия |
| AF-2415GL2 | Ø2.4x1500 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2417GL2 | Ø2.4x1700 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2421GL2 | Ø2.4x2100 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-2423GL2 | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |


Для извлечения круглых и сыпучих предметов.

# Многоразовые электрохирургические электроды

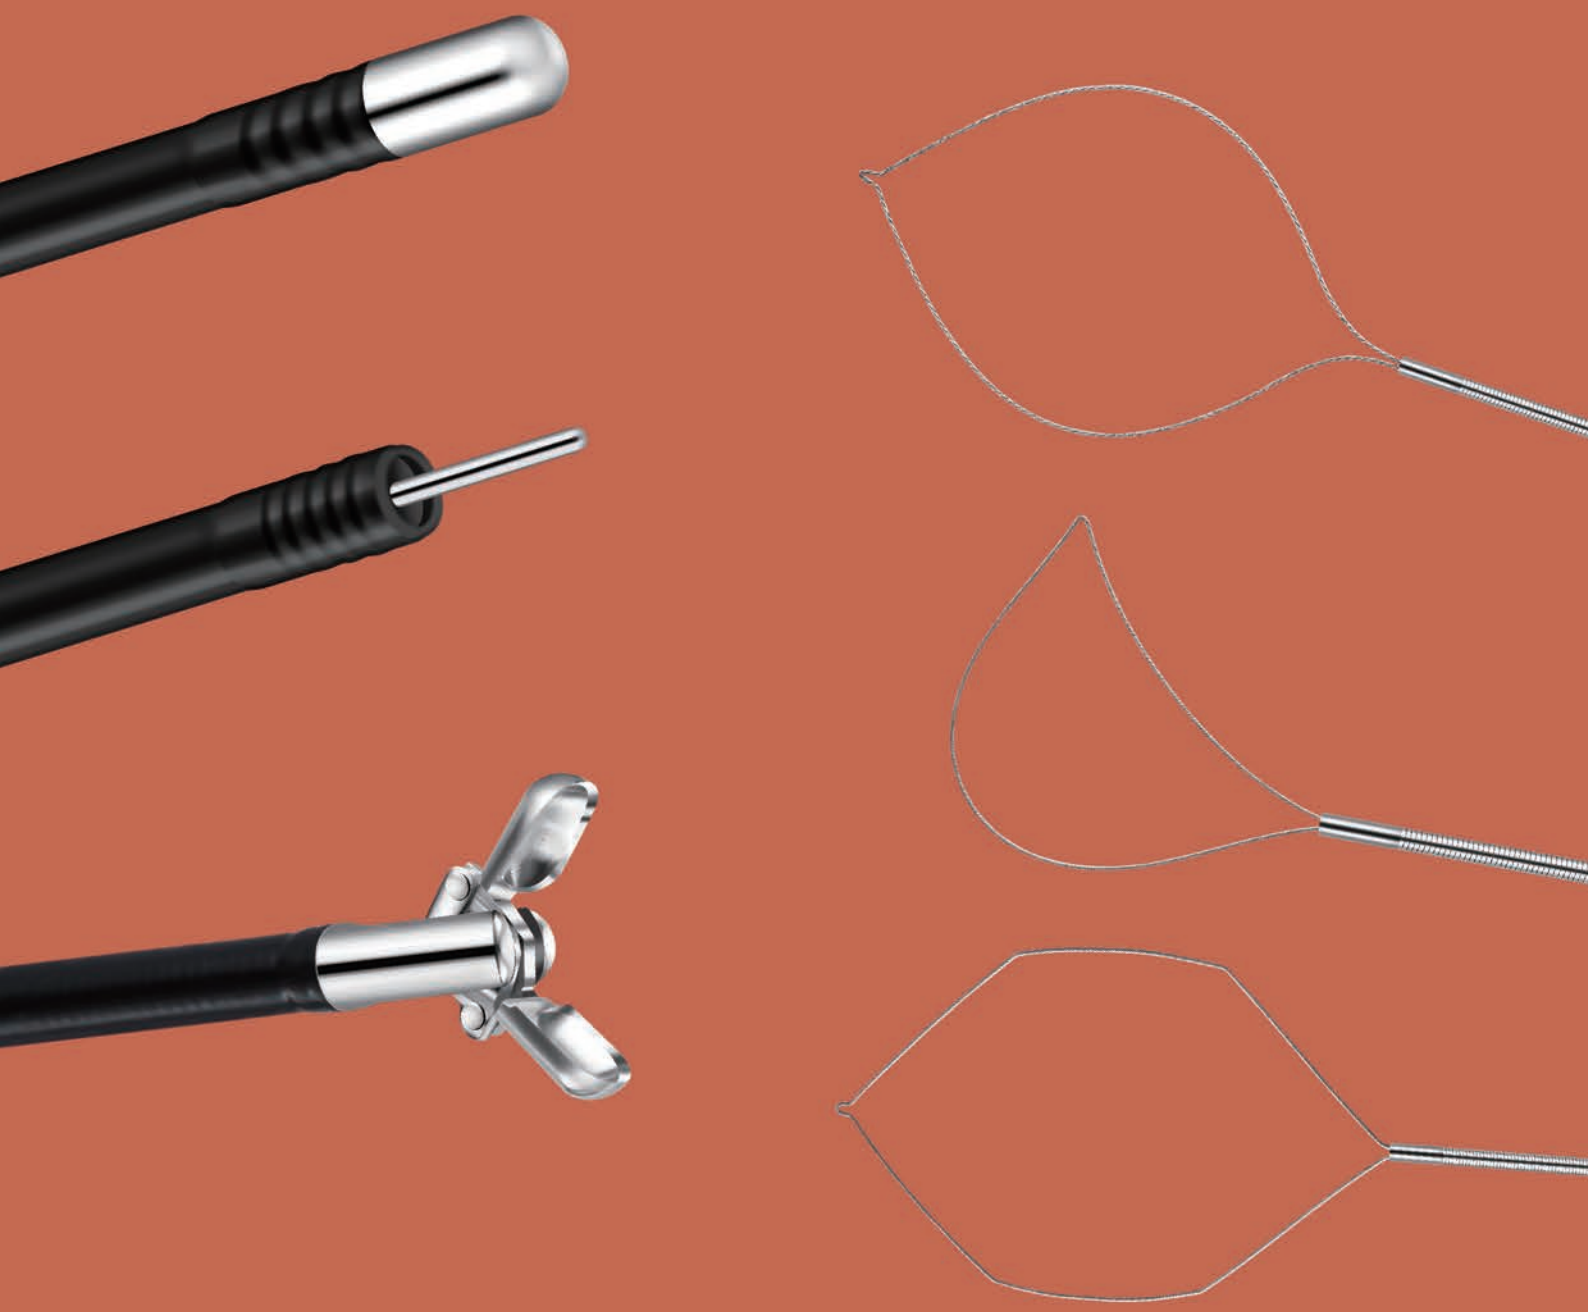

## Многоразовый электрохирургический игольчатый нож

AUTOCLAVABLE 132°C 270°F

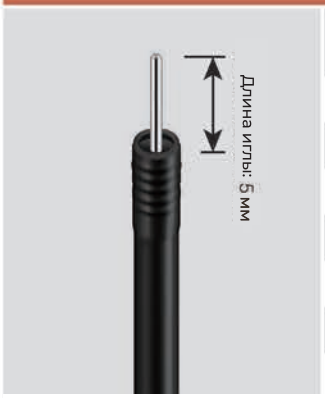


| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-1810DZ | Ø1.8x1000 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-1815DZ | Ø1.8x1500 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-1825DZ | Ø1.8x2500 мм | ≥Ø2.0 мм | Энтероскопия |
| AF-2415DZ | Ø2.4x1500 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2417DZ | Ø2.4x1700 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2421DZ | Ø2.4x2100 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-2423DZ | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |

Разрезает ткань с помощью высокочастотного тока. В стандартный набор входит: одна ручка, два электродных провода.

## Многоразовый коагуляционный электрод

AUTOCLAVABLE 132°C 270°F



| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-1810DQ | Ø1.8x1000 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-1815DQ | Ø1.8x1500 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-1825DQ | Ø1.8x2500 мм | ≥Ø2.0 мм | Энтероскопия |
| AF-2415DQ | Ø2.4x1500 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2417DQ | Ø2.4x1700 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2421DQ | Ø2.4x2100 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-2423DQ | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |

Для коагуляции кровеносных сосудов. Сменные наконечники для коагуляциии. В стандартный набор входят: одна ручка, восемь наконечников.

## Многоразовые горячие щипцы для биопсии

AUTOCLAVABLE 132°C 270°F




| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-1810DG | Ø1.8x1000 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-1815DG | Ø1.8x1500 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-1825DG | Ø1.8x2500 мм | ≥Ø2.0 мм | Энтероскопия |
| AF-2415DG | Ø2.4x1500 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2417DG | Ø2.4x1700 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2421DG | Ø2.4x2100 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-2423DG | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |

Для удаления небольших полипов и коагуляции мелких сосудов.

## Многоразовая электрохирургическая петля (овального типа)

| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-1810DT | Ø1.8x1000 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-1816DT | Ø1.8x1600 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-1825DT | Ø1.8x2500 мм | ≥Ø2.0 мм | Энтероскопия |
| AF-2416DT | Ø2.4x1600 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2421DT | Ø2.4x2100 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-2423DT | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |

Ширина раскрытия:
(Ø1.8) 10/15/20 мм
(Ø2.4) 10/15/20/25/30/35 мм



Вырезает полип с помощью высокочастотного тока. Может вращаться. Стандартный набор включает: одну ручку, два зажима.

## Многоразовая электрохирургическая петля (шестигранного типа)

| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-1810DL | Ø1.8x1000 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-1816DL | Ø1.8x1600 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-1825DL | Ø1.8x2500 мм | ≥Ø2.0 мм | Энтероскопия |
| AF-2416DL | Ø2.4x1600 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2421DL | Ø2.4x2100 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-2423DL | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |

Ширина раскрытия:
(Ø1.8) 10/15/20 мм
(Ø2.4) 10/15/20/25/30/35 мм



Вырезает полип с помощью высокочастотного тока. Может вращаться. Стандартный набор включает: одну ручку, два зажима.

## Многоразовая электрохирургическая петля (тип «Полумесяц»)


| Номер изделия | Диаметр трубки и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-1810DB | Ø1.8x1000 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-1816DB | Ø1.8x1600 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-1825DB | Ø1.8x2500 мм | ≥Ø2.0 мм | Энтероскопия |
| AF-2416DB | Ø2.4x1600 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2421DB | Ø2.4x2100 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-2423DB | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |

Ширина раскрытия:
(Ø1.8) 10/15/20 мм
(Ø2.4) 10/15/20/25/30/35 мм



Вырезает полип с помощью высокочастотного тока. Может вращаться. Стандартный набор включает: одну ручку, два зажима.

# Многоразовые принадлежности

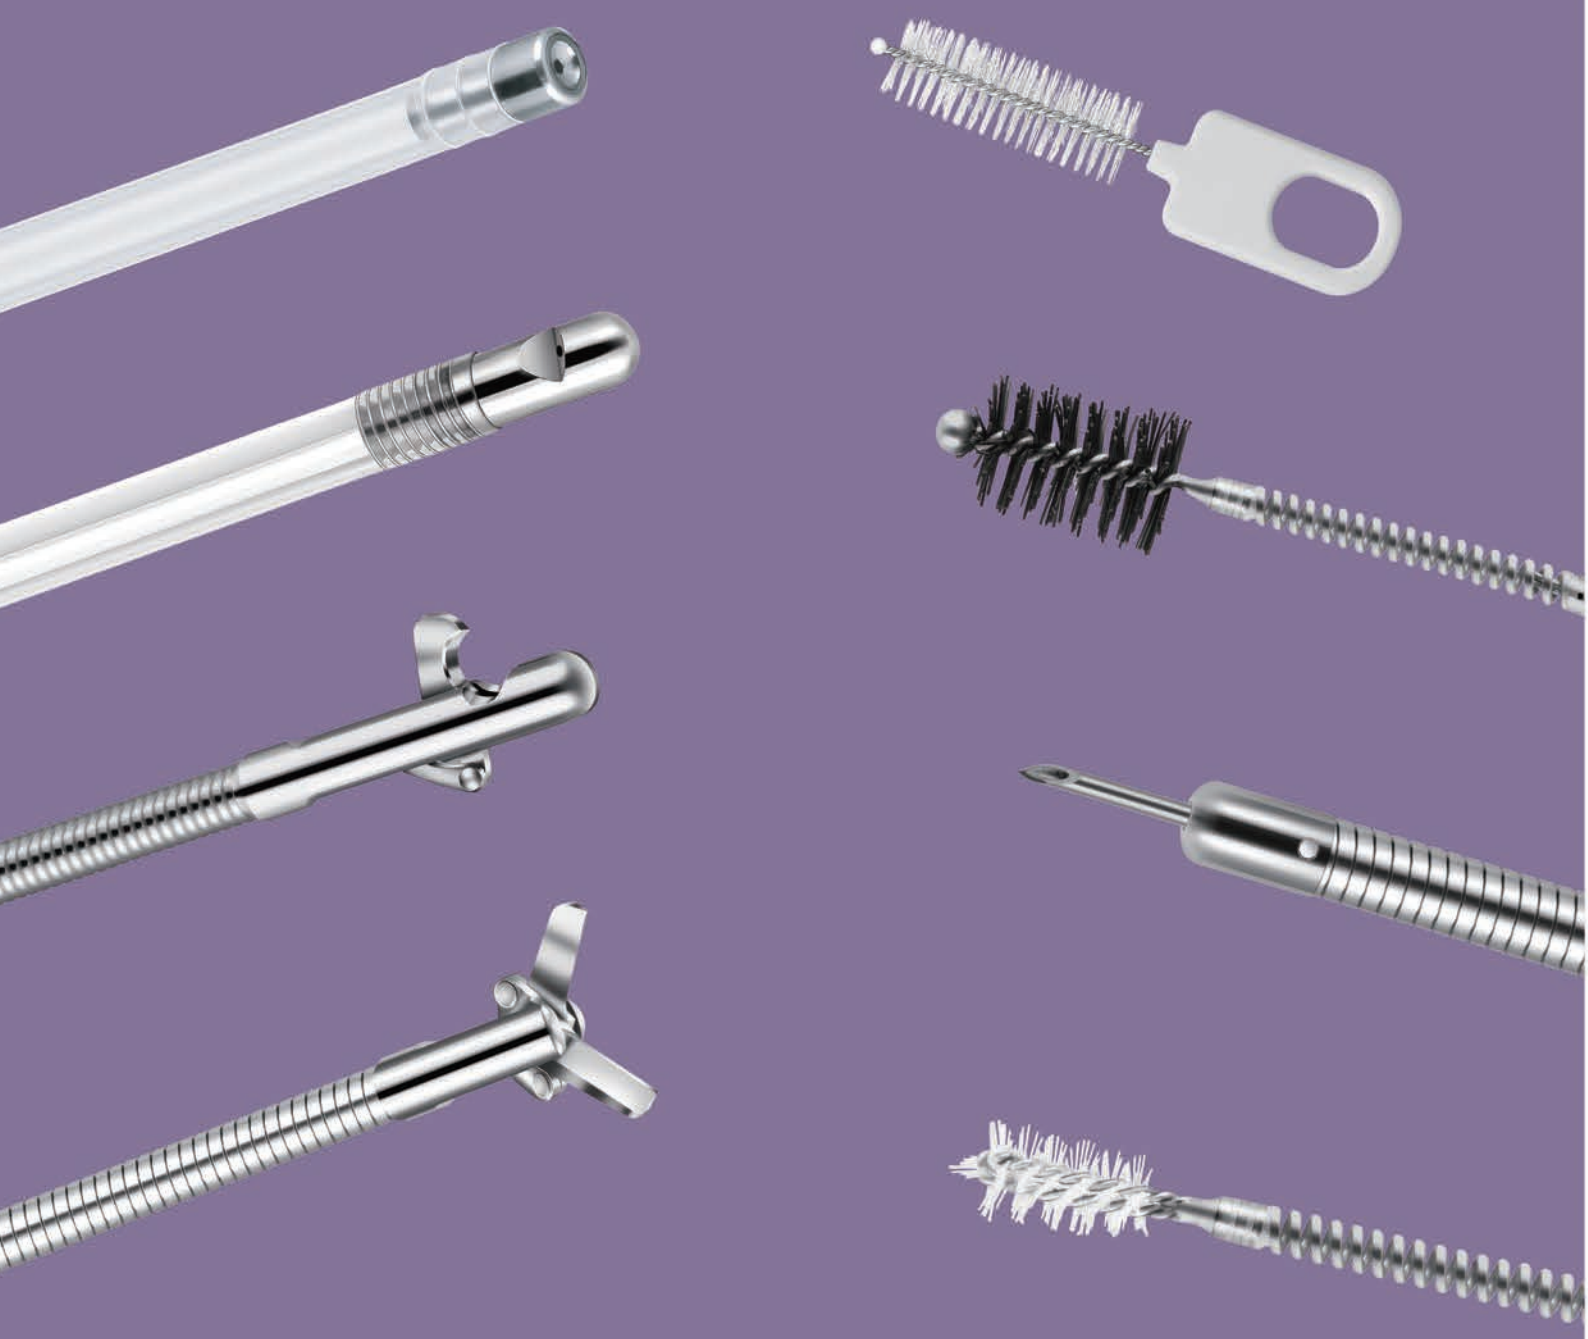

## Многоразовый спрей-катетер (стандартный тип)

| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-1807PA | Ø1.8x700 мм | ≥Ø2.0 мм | Холедоскопия |
| AF-1810PA | Ø1.8x1000 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-1816PA | Ø1.8x1600 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-1825PA | Ø1.8x2500 мм | ≥Ø2.0 мм | Энтероскопия |
| AF-2416PA | Ø2.4x1600 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2422PA | Ø2.4x2200 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |



## Многоразовый спрей-катетер (распыление тумана)

| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-1807PB | Ø1.8x700 мм | ≥Ø2.0 мм | Холедоскопия |
| AF-1810PB | Ø1.8x100 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-1816PB | Ø1.8x160 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-1825PB | Ø1.8x250 мм | ≥Ø2.0 мм | Энтероскопия |
| AF-2416PB | Ø2.4x160 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2422PB | Ø2.4x220 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |



## Многоразовый спрей-катетер (тип «Обратный впрыск»)

| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-1807PC | Ø1.8x700 мм | ≥Ø2.0 мм | Холедоскопия |
| AF-1810PC | Ø1.8x1000 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-1816PC | Ø1.8x1600 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-1825PC | Ø1.8x2500 мм | ≥Ø2.0 мм | Энтероскопия |
| AF-2416PC | Ø2.4x1600 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2422PC | Ø2.4x2200 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |



## Многоразовый цитологический ерш

| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-1810WB | Ø1.8x1000 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-1816WB | Ø1.8x1600 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-2416WB | Ø2.4x1600 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2423WB | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |



## Многоразовые хирургические ножницы

AUTOCLAVABLE 132°C 270°F




| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-2415GO101 | Ø2.4x1500 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2417GO101 | Ø2.4x1700 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2421GO101 | Ø2.4x2100 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-2423GO101 | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |

## Многоразовые лигатурные ножницы

AUTOCLAVABLE 132°C 270°F




| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-2415GO102 | Ø2.4x1500 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2417GO102 | Ø2.4x1700 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2421GO102 | Ø2.4x2100 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |
| AF-2423GO102 | Ø2.4x2300 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |

## Многоразовые очищающие ерши




| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Область применения |
|---|---|---|---|
| AF-1810WA301 | Ø1.8x1000 мм | ≥Ø2.0 мм | Бронхоскопия |
| AF-1816WA301 | Ø1.8x1600 мм | ≥Ø2.0 мм | Гастроскопия |
| AF-2416WA301 | Ø2.4x1600 мм | ≥Ø2.8 мм | Гастроскопия |
| AF-2422WA301 | Ø2.4x2200 мм | ≥Ø2.8 мм | Колоноскопия |

## Многоразовые ерши для чистки отверстий

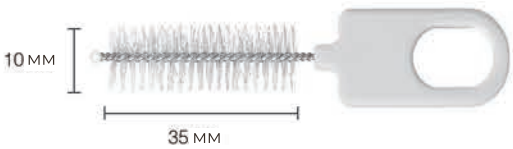



| Артикул |
|---|
| AF-1004WA303 |

## Многоразовая инъекционная игла (металлическая оболочка)




| Артикул | Диаметр вводимой части и рабочая длина | Диаметр рабочего канала | Длина иглы | Диаметр иглы | Область применения |
|---|---|---|---|---|---|
| AF-1807PN**** | Ø1.8x700 мм | ≥Ø2.0 мм | 4/5 мм | 23/25G | Холедоскопия |
| AF-1810PN**** | Ø1.8x1000 мм | ≥Ø2.0 мм | 4/5/6 мм | 23/25G | Бронхоскопия |
| AF-1816PN**** | Ø1.8x1600 мм | ≥Ø2.0 мм | 4/5/6 мм | 23/25G | Гастроскопия |
| AF-2416PN**** | Ø2.4x1600 мм | ≥Ø2.8 мм | 4/5/6 мм | 21/23/25G | Гастроскопия |
| AF-2422PN**** | Ø2.4x2200 мм | ≥Ø2.8 мм | 4/5/6 мм | 21/23/25G | Колоноскопия |

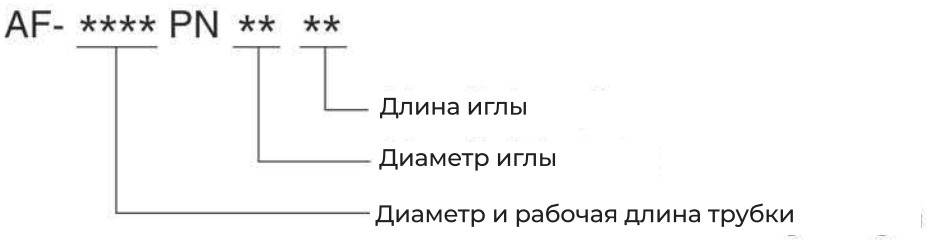

Alton
INNOVATION CREATES BRILLIANT FUTURE

Alton (Shanghai)
Medical Instruments Co.,Ltd



+7 (495) 247-00-07
info@alton.com.ru

alton.com.ru